

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEARACTA DE INSPECCIÓN

Don [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para la Comunidad Foral de Navarra,

CERTIFICA:


Que se ha personado el día diez de septiembre de dos mil nueve en la factoría de IBERTISSUE, S.L.U., sita en e [REDACTED] en BUÑUEL (Navarra).-----

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva de segunda categoría, destinada a la medida de gramaje de papel, ubicada en el emplazamiento referido, y cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Dirección General de Industria y comercio del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo del Gobierno de Navarra con fecha 9 de agosto de 2006.-----

Que la inspección fue recibida por D. [REDACTED], Director de la factoría, D. [REDACTED] Supervisor de la instalación radiactiva y D. [REDACTED] Responsable de Medio Ambiente y Prevención de Riesgos de la factoría, en representación del titular, quienes manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.-----

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el Acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.-----

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal antes citado, resulta que:

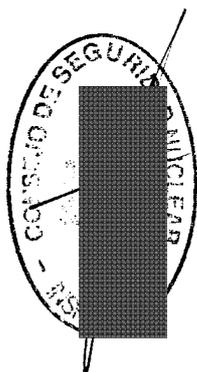

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- En la "Maquina de papel" se encontraba instalado y en funcionamiento, un equipo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED], provisto de una fuente radiactiva de Cripton-85, modelo [REDACTED], con n° de serie [REDACTED], de 14.8 GBq (400 mCi) de actividad en fecha 8/9/06.-----

- Estaban disponibles los documentos requeridos en la especificación 17ª de la referida autorización.-----

- El equipo radiactivo disponía, de forma visible, de sus correspondientes placas de identificación y de señalización luminosa indicadora de su funcionamiento.-----

- La instalación se encontraba señalizada de acuerdo con el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, disponiendo de medios para establecer un acceso controlado.-----


- Disponen de un contrato con la firma [REDACTED] para la realización del mantenimiento y calibración del equipo con una periodicidad anual.-----


- Disponen de un contrato-tipo con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) para la futura retirada de la fuente radiactiva fuera de uso.-----

- Disponen de un equipo para la detección y medida de la radiación, de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] con n° de serie 1187, calibrado por la UNIVERSIDAD [REDACTED] en fecha 5/09/09. Que disponían de un procedimiento específico para la calibración y verificación de dicho detector.-----

- De los niveles de radiación medidos en las proximidades del equipo radiactivo, no se deduce puedan superarse, en condiciones normales de operación, los límites de dosis establecidos.-----

- Estaba disponible el documento justificativo de que el personal de la instalación (6 trabajadores) había recibido el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia. Que la instalación tenía implantado un Programa de Formación bienal para dichos trabajadores.-----

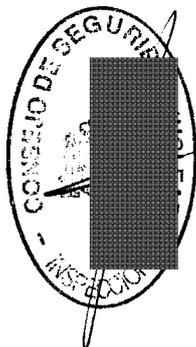

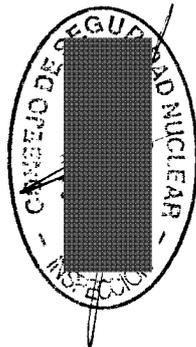SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- Estaba disponible y vigente una Licencia de Supervisor a nombre de D. [REDACTED], persona que no pertenece a la plantilla de la empresa y a la cual realiza visitas periódicas.-----

- Realizan el control dosimétrico del personal de la instalación mediante dos dosímetros de área de termoluminiscencia, procesados, por la firma [REDACTED] de Madrid, registrándose las dosis recibidas.-----

- Estaban disponibles los certificados actualizados de los reconocimientos médicos del personal de la instalación, realizados por el Servicio de Prevención Ajeno [REDACTED] de Navarra.-----

- Estaba disponible el Diario de Operación de la Instalación, debidamente diligenciado y cumplimentado.-----

- Habían remitido al C.S.N. y al Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra el Informe Anual de actividades correspondiente a 2008.-----

- Que estaban disponibles extintores de incendios.-----


DESVIACIONES:

- La instalación no había implantado las exigencias recogidas en la instrucción IS-18.-----

Que con el fin de quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1836/1999 (modificado por el Real Decreto 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y las referidas autorizaciones, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Pamplona y en la sede del Instituto de Salud Pública, a once de septiembre de dos mil nueve.


SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de IBERTISSUE, S.L.U., para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

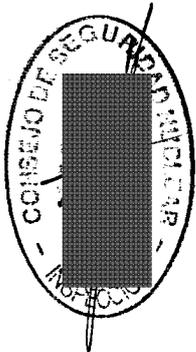

Con fecha 21 de Septiembre de 2009, se ha enviado mediante correo certificado, una copia de nuestro Plan de Emergencia reeditado y en el cual se incluye expresamente todo lo referido en la instrucción IS-18.

Dicha copia, obra en poder de la Subdirección General de Protección Radiológica Operacional del CSN. Con esto consideramos subsanada la desviación que en este acta se refleja.

**Ibertissue**
SOFIDELFDO [Redacted]
DIRECTOR DE PLANTA.

SN


CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

DILIGENCIA.- En relación con el Acta de referencia CSN-GN/AIN/04/IRA/2821/09 de fecha 11 de septiembre de 2009, el Inspector que la suscribe declara con relación a los comentarios formulados en el TRÁMITE de la misma:

- Hoja 4, Comentario único.
El comentario no modifica el contenido del Acta.

En Pamplona, a 30 de septiembre de 2009

EL INSPECTOR



Fdo

