



CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

CSN/AIN/01/RX/AL-1335/09
Hoja 1 de 3

ENTRADA 16801
: 10-08-2009 14:08

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día dieciséis de julio de dos mil nueve en la CLINICA DENTAL "LOS PINOS", cuyo titular es D^a [REDACTED], de NIF [REDACTED] y que se encuentra en la calle [REDACTED] en Huercal de Almería (C.P.-04230).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde fecha 21/04/2003

Que la Inspección fue recibida por D^a [REDACTED] auxiliar de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación tiene 1 único equipo intraoral, de marca y modelo [REDACTED] y nº de serie 851181, con Radiovisiografía y con marcado CE visible. _____
- La sala, no plomada, está reglamentariamente señalizada. _____
- Disponían de un delantal plomado. _____

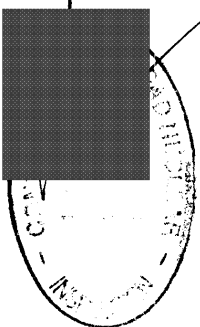

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- Para disparar el equipo se disponía de un interruptor en el exterior. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN


- Mientras se efectuaban disparos, sobre un fantoma de agua, con disparos de 0'42 seg, se midieron 5 μ Sv/h en la ubicación del operador.

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- La titular dispone de Acreditación del CSN para Dirigir. _____
- Según se manifestó, la titular es la única persona considerada expuesta a radiaciones. Las dosis actualizadas acumuladas a 03/2009 de su dosímetro eran menores a 0'2 mSv en los últimos 12 meses. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN


- Según manifestaron, se realizan menos de 4 radiografías semanales. _
- Se ha sido realizado un control de calidad durante en fecha 13/03/2009, por parte de la UTPR _____
- Se ha recibido en el CSN el informe anual correspondiente al año 2008, remitido por la UTPR _____ en formato electrónico. Según dicho Informe, se hizo un control de calidad en 12/02/2008. En él se reseña una anomalía en cuanto a reproducibilidad de la tensión aunque no se informa de ella en las conclusiones del mismo informe. _____

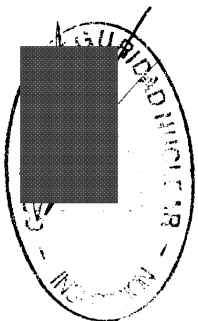

DESVIACIONES

- No disponían de carteles de aviso a embarazadas, incumpléndose por tanto el artículo 9.1 del Real Decreto 1976/1999 sobre criterios de control de calidad en radiodiagnóstico. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a treinta de julio de dos mil nueve.

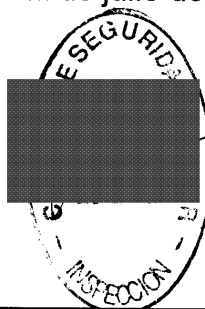

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del Centro **"CLINICA DENTAL LOS PINOS"** (Huerca de Almería) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

D^a [REDACTED] con NIF [REDACTED] titular de la Instalación de Radiodiagnóstico Médico con nº de registro AL-1335, que se encuentra en la calle [REDACTED] en Huércal de Almería (Almería),

MANIFIESTA:

Que en la visita realizada el pasado día 16 de julio de 2009 a esta instalación por D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear, se le informó de la existencia de un cartel de aviso a embarazadas situado en la sala de espera, en lugar visible.

Que en dicho cartel se hace referencia al RD 1976/1999 sobre Criterios de Calidad en Radiodiagnóstico. Le adjunto fotografías de su ubicación.

Que D. [REDACTED] después de ser informado, no llegó a entrar en dicha sala para comprobar la realidad de lo dicho.

En Huércal de Almería, a 7 de Agosto de 2009

del
Fdo.: [REDACTED]