

**ACTA DE INSPECCION**

---

Dr. [REDACTED] acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como Inspector para el Control y Seguimiento de Instalaciones Radiactivas, Rayos X médicos y Transporte de sustancias nucleares, materiales y residuos radiactivos, dentro del Territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

**CERTIFICA** : Que se ha personado el día dieciocho de Marzo de dos mil once en la Clínica Palma Planas con CIF: [REDACTED] sita en [REDACTED] CP 07010 de Palma. Mallorca.


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de Rayos-X ubicada en el emplazamiento referido y cuya instalación figura inscrita en la Dirección General de Industria de Baleares.

Que la Inspección fue recibida por el Dr. [REDACTED] responsable de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación de Rayos - X consta de:
  - Sala 1, equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 150KV y 630mA de características máximas.
  - Sala 2, equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 150KV y 630mA de características máximas.
  - Sala 3, equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 140KV y 400mA de características máximas.
  - Sala 4, equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 85KV y 12mA de características máximas.
  - Sala 5, equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 35KV y 350mA de características máximas.
  - Sala 6, equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 150KV y 640mA de características máximas.
  - Sala 7, equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 90KV y 200mA de características máximas.
  - Sala 8, equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 125KV y 1250mA de características máximas.
  - Sala 9, equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 110KV y 13mA de características máximas.
  
- Que se han efectuado modificaciones en la instalación, tales como cambio de equipos, no inscritas en el Registro General de Rayos-X de la Dirección General de Industria.
  
- Que el quince de Marzo de dos mil once la UTPR [REDACTED] llevó a cabo la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo y que el correspondiente certificado está pendiente de expedición.

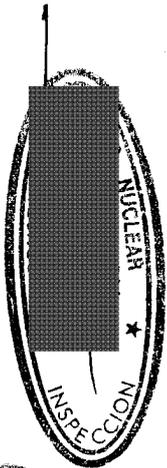

- Que estaba disponible el control dosimétrico del personal profesionalmente expuesto.
- Que se dispone de la acreditación para dirigir la instalación de Rayos-X.
- Que se dispone de la acreditación para operar la instalación de Rayos-X.
- Que se dispone de prendas de protección suficientes para el personal de la instalación.
- Que la instalación se encuentra debidamente señalizada.
- Que no estaba disponible el "Programa de Protección Radiológica".

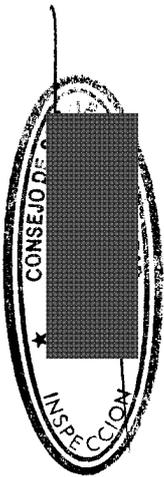

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, Real Decreto 793/2001 y el Real Decreto 1836/1999 , de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, y el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico y del Acuerdo entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares del treinta y uno de Mayo de 1985, la entrada en vigor del mencionado acuerdo de fecha tres de Abril de 1987, la posterior revisión y ampliación del acuerdo de fecha 27 de Julio de 1989, y el Real Decreto 111/1995, de 27 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en Palma de Mallorca en la Consejería de Comercio, Industria y Energía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a veintiuno de Marzo de dos mil once.

**CSN**

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

**TRAMITE.-** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado de la Instalación de Rayos-X, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

