



ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para la Comunidad Foral de Navarra,

CERTIFICA: Que se ha personado, sin previo aviso, el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en la **Clínica Dental ENDOPERIO**, sita en [REDACTED], en PAMPLONA (Navarra), con NIF [REDACTED]-----

La visita tuvo por objeto el control del funcionamiento de la instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, cuyo código de registro es NA-1512 a nombre de **ENDOPERIO, S.L.P.**, y cuya última notificación de inscripción fue realizada en fecha 17 de noviembre de 2015.-----


La Inspección fue recibida por D.ª [REDACTED] odontóloga contratada por la clínica, y D.ª [REDACTED] administrativa, quienes aceptaron la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la Protección Radiológica.-----

Las representantes del titular de la instalación fueron advertidas previamente al inicio de la inspección que el Acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.-----

De las comprobaciones realizadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal antes citado, resulta que:

UNO. INSTALACIÓN

- La instalación consistía en una sala en las cual se encontraba instalado un equipo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] con nº de serie 3202894, de 65 kV y 7 mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente. Que dicho equipo disponía de sus correspondientes placas de identificación.-----

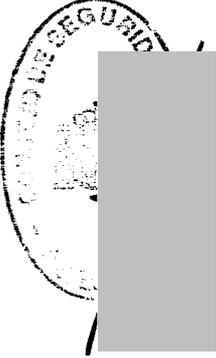

- Con dicho equipo se utiliza la técnica digital.-----

- La sala se encontraba señalizada de acuerdo con el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes.-----

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- Estaba disponible el siguiente material de protección radiológica: un delantal plomado, dotado de protector tiroidal, de 0,3 mm de espesor.-----

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN

- Fueron medidos los niveles de radiación con los siguientes resultados: Condiciones de disparo: 65 kV, 7 mA y 0.32 seg. En el puesto ocupado por la operadora del equipo, en el exterior de la sala, tasa de dosis: Fondo radiológico ambiental. En el puesto ocupado por la administrativa en Admisión, tasa de dosis: 20 μ Sv/h.-----

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- Estaban disponibles dos acreditaciones para dirigir el funcionamiento de la instalación a nombre de D.ª [REDACTED] y D. [REDACTED] odontólogo titular de la clínica, y una para operar con el equipo a nombre de D.ª [REDACTED], higienista de la clínica.-----

- Realizan el control dosimétrico de las trabajadoras clasificadas como expuestas, D.ª [REDACTED] de D.ª [REDACTED] y D.ª [REDACTED] administrativa de la clínica, mediante el uso de dosímetros personales de termoluminiscencia, procesados por la firma [REDACTED] archivándose los informes dosimétricos correspondientes, en los cuales no se reseñaba ninguna dosis anómala.-----

- Las trabajadoras expuestas a las radiaciones estaban clasificadas como categoría "B".-----



CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Estaban disponibles el Programa de Protección Radiológica de la instalación y las Normas Básicas de Protección Radiológica.-----

- Estaban disponibles los informes de los controles de calidad del equipo, así como los de la medida de la radiación y cálculo de dosis a pacientes, realizados por la UTPR [redacted]. Que la última revisión fue realizada en fecha 10/06/16.--

- Estaba disponible el contrato de prestación de servicios entre la UTPR y el titular de la instalación. Que estaba disponible el certificado de conformidad de la instalación de fecha 9/12/16.-----

- Según se manifestó, el equipo no había sido intervenido ni reparado desde su instalación.-----

SEIS. DESVIACIONES

- No se detectaron.-----

Con el fin de quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y el RD 1085/2009 sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en la sede del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, en Pamplona a veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **ENDOPERIO, S.L.P.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o repar

Conforme con el acta

firmado:



operi