

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día doce de septiembre de dos mil siete en la **POLICLÍNICA MAZARRON DKV** (antes Policlínica Seguros [REDACTED]), cuyo titular es "DKV Servicios", de CIF [REDACTED] y que se encuentra en la calle [REDACTED], en 30870-Mazarrón (Murcia).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que figura inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Murcia desde fecha 21/02/2002.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Director Gerente del Centro, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.

Que acompañó al inspector D. [REDACTED], inspector acreditado de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de Murcia.


Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se componía de tres equipos instalados en dos salas,

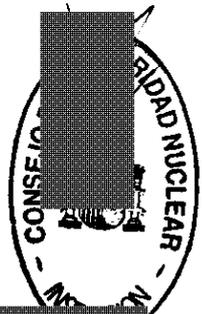

ambas señalizadas con trébol. Según manifestaron, la sala en la que estaban los equipos general y dental panorámico tiene las paredes y puerta plomadas. _____



- Los equipos son:
 - Uno de radiografía general, _____ con brazo Vertex UM con bucky y tubo solidarios.
 - Un dental intraoral _____, de nº XAPA/034-49269.
 - Un dental panorámico _____
- Era visible un cartel de aviso a embarazadas. _____
- Disponían de un delantal plomado. _____
- En los tres equipos, la ubicación del operador está en el exterior de la sala, accionando un pulsador de pared. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma de agua con los distintos equipos, en las zonas de control se midieron los siguientes valores de tasa de dosis: equipo general : 2'7 μ Sv/h; ortopantografía, 0'6 μ Sv/h; telerradiografía, 1'6 μ Sv/h; equipo intraoral, 0'2 μ Sv/h. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Según manifestaron, el Director es D. _____ para dos de los equipos, y D^a _____ para el equipo intraoral. Ambos disponen de Acreditación para Dirigir. Las operadoras son D^a _____ y D^a _____ que disponen de Acreditación para Operar. _____
- Se efectúa la vigilancia dosimétrica de los 3 trabajadores expuestos mediante dosimetría personal, siendo los valores actualizados de los registros dosimétricos de 0'00 mSv en dosis acumulada anual, excepto en el caso de D^a _____, que ha estado utilizando hasta la fecha un dosímetro a nombre de _____ una operadora que trabajó anteriormente en esta instalación, y que acumula _____ mSv/año. Se ha corregido el nombre de la usuaria actual, desde fecha 1/09/2007. _____

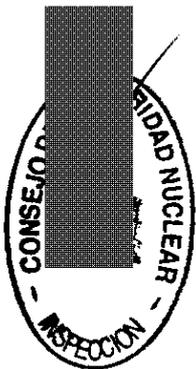


CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Según manifestaron, el Apercebimiento que les fue remitido el año anterior no fue contestado por el cambio de titular y por grave enfermedad del anterior titular. _____
- El último control de calidad fue realizado por la UTPR  en fecha 22/08/2007. En su informe no se observan anomalías. _____

DESVIACIONES

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintisiete de septiembre de dos mil siete.

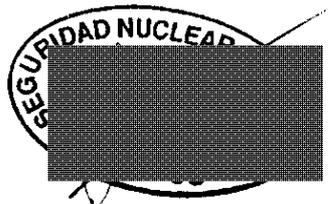

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "POLICLINICA MAZARRON DKV" (Mazarrón) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.