

183714

CSN/AIN/15/IRA/1584/09

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día nueve de junio de dos mil nueve, en DR. [REDACTED] (SANATORIO LA MILAGROSA), sito en [REDACTED] en Madrid.


Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medicina nuclear, cuya última autorización de modificación (MO-6) fue concedida por la Comunidad de Madrid con fecha 27 de marzo de 2006.

Que la Inspección fue recibida por el Dr. D. [REDACTED] Supervisor, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:


- Las dependencias que constituyen la instalación radiactiva se encuentran señalizadas y disponen de medios para establecer un acceso controlado. _____
- En el Diario de Operación figura el gasto de material radiactivo. _____
- Disponen de un densitómetro óseo [REDACTED] efectuando el mantenimiento [REDACTED] _____
- Los generadores agotados los retiran los suministradores, disponen de un sistema para la eliminación de residuos radiactivos líquidos y los residuos sólidos se almacenan en un pozo blindado, dentro de la

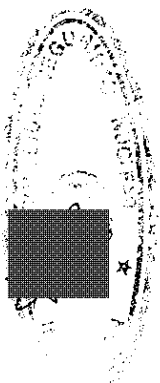

cámara caliente, hasta su decaimiento y posteriormente eliminados como residuo biológico. _____

- El monitor de radiación ha sido calibrado en el _____ con fecha 3 de marzo de 2006. _____
- Disponen de cuatro Licencias de Supervisor y una de Operador. _____
- El personal expuesto, está clasificado en la categoría A. _____
- Efectúan reconocimientos médicos anuales en _____
- Disponen dosímetros personales, en los que figuraban los siguientes datos, correspondientes a dosis acumuladas en 2008:

NOMBRE	PUESTO	DOSIS PROF.	DOSIS SUP.
_____	Supervisor	0,21	0,21
_____	Supervisor	20,10	19,73
_____	Supervisor	8,73	8,75
_____	Supervisor	11,73	11,20
_____	Operadora	35,91	34,67
_____	Densitometría	0,86	0,83
_____	Enfermera	36,82	35,59
_____	Técnico	15,39	14,78
_____	Recepcionista	6,26	6,13

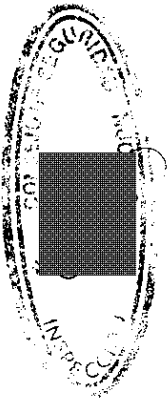


- Han remitido al CSN el Informe Anual. _____

DESVIACIONES

- Los datos dosimétricos muestran unos valores por encima de los esperados en este tipo de instalación, así como dosis relevantes en personal sin Licencia de operación, incluida la recepcionista. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diez de junio de dos mil nueve.

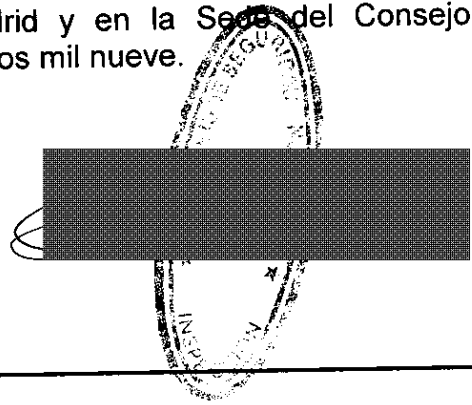

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de DR. [REDACTED] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

En relación con la información dosimétrica he de informarle que he notado un error de transcripción a la reunión de 2008:

En el Apartado "Dosis total del año natural" figura la dosis acumulada a los últimos cinco años.

Para corregir este error he solicitado a informe del centro de Instrucción a el que figura la dosis acumulada a el mes de 2008 y otro en los referidos a la reunión de 2009.

Propenso a disuadir el error de transcripción y tengo a bien actualizar los referidos datos dosimétricos

Madrid 27 de junio de 2009

ENTRADA 13657

Fecha: 24-06-2009 15:21

Centro de Medicina Nuclear

Dr. [REDACTED]

Clinica la Milagrosa

Tel [REDACTED]

28010 MADRID

Consejo de Seguridad Nuclear

Dr. [REDACTED]

Justo Dorado 11

28040 MADRID

Madrid 22 de Junio de 2009

Querido amigo:

Te adjunto la copia firmada de la inspección, referencia CSN/AIN/13/IRA/1584/07 del pasado 9 de Junio.

En el apartado de TRÁMITE, especificamos que ha habido un error de transcripción en la memoria anual, al figurar la dosis acumulada en los últimos 5 años en la casilla de la Dosis Total del Año Natural.

Para subsanarlo te adjunto los certificados con las dosis reales emitidos por el [REDACTED]

Te ruego disculpes el error y tengas a bien actualizar los referidos datos dosimétricos.

Gracias como siempre y un fuerte abrazo.

[REDACTED]

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia CSN/AIN/15/IRA/1584/09 de fecha nueve de junio de dos mil nueve, correspondiente a la inspección realizada a Dr. [REDACTED] sito en [REDACTED] en Madrid.

D [REDACTED] como titular de la instalación, manifiesta una serie de alegaciones al contenido de la misma

El inspector que la suscribe manifiesta la aceptación de las aclaraciones que se describen.

Madrid, 25 de junio de 2009

[REDACTED]

Fdo.: [REDACTED]