

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día veinte de diciembre de 2010 en la instalación de rayos X que la entidad Zafrilla Servicios Médicos Sanitarios y Prevención, S.L., de NIF: [REDACTED] sita en [REDACTED], bajo, de Yecla, Murcia.

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en [REDACTED] domicilio citado, destinada a radiodiagnóstico médico, cuya última inscripción registral es de 11 de abril de 2005.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Administrador y Operador de la instalación.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS


- La instalación de rayos X se encuentra en una sala ubicada en planta semisótano de un edificio de viviendas, que contiene los dos equipos existentes. La puerta de la sala, visor y paredes están plomados. _____
- Los equipos de rayos x existentes son: Un [REDACTED] modelo [REDACTED] y nº de serie 38-04-29-97/13 D324 y un equipo [REDACTED] modelo [REDACTED] nº serie 58180335/39805069. _____

C O P I A

██████████

- La sala de rayos X está reglamentariamente señalizada, disponiendo de control de accesos a la misma. Dispone de puerta plomada; dos de las paredes colindan con el terreno y las otras dos con sala de rehabilitación, puesto de control y pasillo de servicio. _____
- Se disponen de un delantal plomado. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

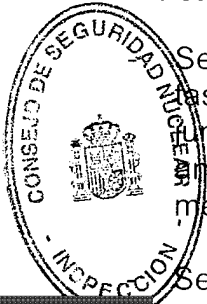

Se realizan varios disparos con los dos equipos, tomándose registros de tasa de dosis en el puesto de control, en la sala de rehabilitación anexa y junto a la puerta de acceso, dando como resultado el fondo radiológico ambiental en todos los casos y 0,80 μ Sv/h junto al dintel de la puerta mencionada. _____

Se manifiesta a la Inspección que se realizan unas cuarenta exploraciones al mes. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Se justifica la acreditación de D. A. ██████████ como director de la instalación. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se disponen de un dosímetro personal, cuya lectura realizada por el ██████████ correspondiente a noviembre de 2010, no arroja valores significativos. _____
- Se verifica la disponibilidad del Control de Calidad anual con fecha 7/10/2010, realizado por la UTPR ██████████ sin destacar anomalías. _____
- La acreditación de Operador presentada es un certificado de un curso de operador emitido por la Fundación Salud y Sociedad de la ██████████ donde no figura la conformidad del CSN. _____

DESVIACIONES

- No dispone de documento de informe anual correspondiente a 2009. _____
- No dispone de contrato con UTPR. _____




- No dispone de Programa de Protección Radiológica. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a veintinueve de diciembre de 2010.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL

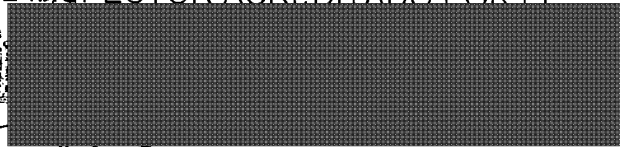

do.: _____

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de Zafrilla Servicios Médicos Sanitarios y Prevención, S.L en Yecla, Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.