

ACTA DE INSPECCION


D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día veintisiete de mayo de dos mil diez en **CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE CADIZ**, sito en [REDACTED] en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección de una instalación radiactiva destinada a irradiación de sangre, cuya autorización fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria Turismo y Comercio en fecha 27 de diciembre de 2006.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Director del Centro, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

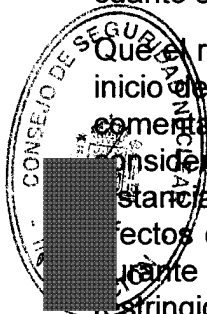

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de dos Licencias de Supervisor y ocho de Operador en vigor, y una licencia de Operador en trámite. _____
- Disponen de dosímetros personales de termoluminiscencia, sin datos significativos. _____
- Disponen de tres dosímetros de área en el interior de la dependencia. __
- En una dependencia de la planta semisótano, señalizada, se encontraba un equipo de la firma [REDACTED] marca [REDACTED]

modelo [REDACTED] nº 047, alojando una fuente de Cs-137 de 75,25 TBq, en fecha 1-10-07, nº 2251GP _____

- [REDACTED] efectúa pruebas de hermeticidad anualmente. _____
- Realizan la asistencia técnica del equipo a través de la empresa [REDACTED] Revisión de mantenimiento anual de fecha 10/05/10. _____
- La dependencia dispone de un sistema de acceso personal electrónico.
- En contacto con el equipo las tasas de dosis medidas fueron fondo. _____
- Disponen de un equipo de medida [REDACTED] nº 634, con sonda nº 417, calibrado en el [REDACTED] con fecha 17/03/08 y verificado por el Servicio de Protección Radiológica del [REDACTED] con fecha 02/12/09.
- Estaba disponible el certificado de actividad de la fuente de Cs-137. _____

El titular manifestó que disponen de acuerdo de devolución de fuentes. _____

Disponen de Diario de Operación, donde figura su utilización. _____

La Inspección informó sobre la obligación de incorporar la Instrucción IS-8 sobre los criterios para la notificación de sucesos e incidentes radiológicos en instalaciones radiactivas, al Plan de Emergencia o al Reglamento de Funcionamiento de la instalación radiactiva. _____


- La Inspección informó sobre la aplicación del artículo 8 bis "Comunicación de deficiencias" del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero. _____
- Han remitido al CSN el informe anual. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la

CSN/AIN/03/IRA/2852/10

Hoja 3 de 2


presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a siete de junio de dos mil diez.

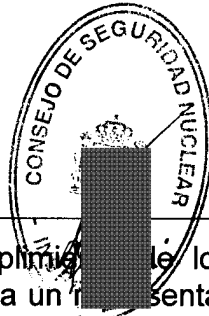

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUÍNEA DE CADIZ** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta

Jerez de la Frontera, a 16 de junio de 2010

Fdo. 



NOTA: no hay ninguna observación sobre el contenido del Acta.