

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintinueve de mayo de dos mil quince en la calle [REDACTED] de Oviedo, donde figura inscrita una instalación cuyo titular [REDACTED] **CLÍNICA DENTAL, S.L.**, [REDACTED].


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por doña [REDACTED] quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en noviembre de 2007 (IR-195).-----

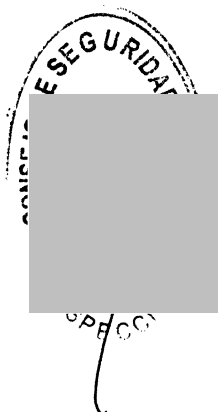

La instalación, de segunda categoría, coincide sensiblemente con la registrada y está señalizada y provista de acceso controlado.-----

Se encuentran instalados un [REDACTED] [REDACTED] (número de serie SEX1085/SEXB078/408173), un [REDACTED] (445101) y un orto [REDACTED] [REDACTED]-----

Disponen de una acreditación para dirigir instalaciones de rayos X; un delantal plomado; así como de Programa de Protección Radiológica realizado [REDACTED] en diciembre de 2012.-----

Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad de los equipos de rayos X por [REDACTED] en diciembre de 2013 y de 2014. Se realiza control dosimétrico de cuatro usuarios por [REDACTED] siendo la última lectura de abril de 2015 sin valores significativos.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a veintinueve de mayo de dos mil quince.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de [REDACTED] **CLÍNICA DENTAL, S.L.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Oviedo 16 de Junio de 2015.

El 02 de Julio de 2013 se metió por registro el alta y baja de 1 equipo orto. Se está pendiente de la inscripción de dicho equipo debido a una disconformidad en el n.º de serie de un equipo [REDACTED] instalado.

Se ha presentado por Registro de industria. contestación a la alegación para que se de el alta y baja del [REDACTED] se adjunta documentación metida por registro. [REDACTED]

