

## ACTA DE INSPECCION

---

Dr. D. [REDACTED] acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como Inspector para el Control y Seguimiento de Instalaciones Radiactivas, Rayos-X médicos y Transporte de sustancias nucleares, materiales y residuos radiactivos, dentro del Territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día diez de septiembre de dos mil diez en las instalaciones de la Clínica Rotger sita en la [REDACTED] de Palma de Mallorca.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de Medicina Nuclear del “Institut de Medicina Nuclear Rotger i CETIR, S.L”, cuya autorización de funcionamiento fue otorgada por la Dirección General de Industria del Gobierno Balear en fecha diecisiete de Julio de dos mil uno.

Que la Inspección fue recibida por la Dra [REDACTED] quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o

documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:


- Que la instalación radiactiva estaba debidamente señalizada.

Que disponen de una licencia de supervisión a nombre de Dña. [REDACTED] válida hasta 15/07/2014.

Que se dispone de una licencia de operador a nombre de D. [REDACTED] [REDACTED] válida hasta 19/02/2014.


- Que efectúan el control dosimétrico del personal profesionalmente expuesto no habiéndose detectado dosis superiores a las establecidas.
- Que según manifestación de la supervisora de la instalación se ha efectuado la vigilancia médica del personal profesionalmente expuesto, no obstante no estaba disponible el informe médico del personal.
- Que el balance de material radiactivo era de un generador de Te-99m de actividad 265 mCi y 64 mCi de Fluor-18, 5mCi de I-131.
- Que estaba disponible el diario de operaciones debidamente diligenciado.

- Que la empresa [REDACTED] recogió 51 generadores decaídos en fecha 25 de marzo de 2010.
- Que la empresa [REDACTED] ha efectuado pruebas para verificar la hermeticidad de las fuentes radiactivas encapsuladas, en octubre de 2009, no habiéndose detectado contaminación radiactiva.
- Que se ha presentado el informe anual.
- Que los equipos marca [REDACTED] modelo [REDACTED] y el segundo modelo [REDACTED] fueron debidamente calibrados el 5 de noviembre de 2009 por el [REDACTED]

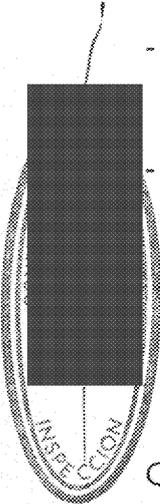

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, Real Decreto 793/2001 y el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, y el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico y del Acuerdo entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares del treinta y uno de Mayo de 1985, la entrada en vigor del mencionado acuerdo de fecha tres de Abril de 1987, la posterior revisión y ampliación del acuerdo de fecha 27 de Julio de 1989, y el Real Decreto 111/1995, de 27 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad

Autónoma de las Islas Baleares, en materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en Palma de Mallorca en la Conserjería de Comercio, Industria y Energía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a trece de septiembre de dos mil diez.

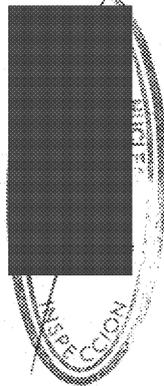

**TRAMITE.-** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado de la Clínica Rotger, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[Redacted signature]

Re.

[Redacted text]

Palma 5 de Octubre 2010

DILIGENCIA:

El titular no presenta alegaciones

Visto y conforme

[Redacted signature]

El Dto. [Redacted]  
18/10 / 2010