



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día diecisiete de septiembre de dos mil catorce en la "Clínica Dental Profesional", que se encuentra ubicada en la calle [REDACTED] de Candeleda (C.P.-05480), en la provincia de Ávila.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico médico, ubicada en el centro referido, y cuyo titular es D. [REDACTED], con CIF/[REDACTED]. La instalación se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León desde fecha 21/05/2013.


Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], titular del Centro, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica..

Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación consta de un solo equipo dental intraoral, de la marca y modelo [REDACTED] n°s WEYA 643. _____
- La sala del equipo estaba señalizada reglamentariamente y disponían de medios para un control de acceso efectivo. También era visible un cartel de aviso a embarazadas sobre la puerta de acceso. _____
- La sala, no plomada, colinda en el mismo plano con la calle, escaleras de la vivienda, pasillo y sala de espera; en el plano superior con una vivienda y en el inferior con el suelo. _____
- El pulsador del equipo, de pared, está situado en el exterior de la sala. _

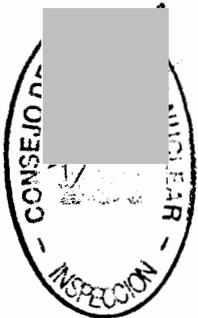



- Disponían de un delantal plomado. _____
- El equipo disponía de Radiovisiografía. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN


- Mientras se utilizaba el equipo se efectuaron medidas de tasa de dosis, obteniéndose valores de 0'6 $\mu\text{Sv/h}$ en la zona de control y 0'4 $\mu\text{Sv/h}$ en la sala de espera adyacente al equipo. _____
- Según manifestaron, realizan menos de 10 radiografías por semana. ____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Según manifestaron, Dirige la instalación D. _____ que dispone de Acreditación del CSN para tal función y opera los equipos únicamente él.
- El control dosimétrico de esta persona es realizado mediante un dosímetro TL Personal, que es leído por _____. Estaban disponibles las lecturas del mismo, con valores acumulados de 0'93 mSv/5años. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se disponía de un contrato escrito con la UTPR SRI. _____
- Se disponía de un informe de resultados de un control de calidad del equipo, revisión de áreas y estimación de dosis a pacientes, efectuados por el técnico D. _____, de la UTPR _____ en 2013. _____
- Disponían de un Programa de Garantía de Calidad y de Protección Radiológica. Disponían también de normas de Protección Radiológica.
- Disponían de un certificado periódico de conformidad, reciente. Ni en él ni en el informe de la visita efectuada por la UTPR constaban anomalías.

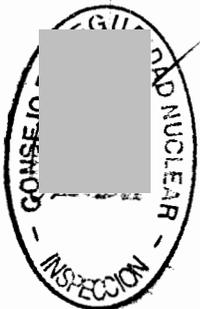


DESVIACIONES

- No se han detectado. _____



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 35/2008 por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a uno de octubre de dos mil catorce.

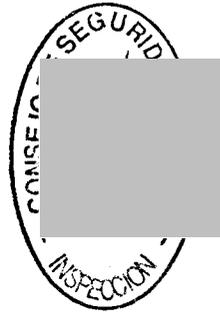

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 35/2008 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "CLINICA DENTAL DR. [REDACTED] (Candeleda) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

