

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día 1 de septiembre de 2014 en Mediavilla i Cia. Veterinària SCP, con NIF [REDACTED] sito en e [REDACTED], [REDACTED] Calella (Barcelona).

Que la visita tuvo por objeto realizar la Inspección de una instalación de radiodiagnóstico veterinario cuya última inscripción fue llevada a cabo en fecha 26.08.2008 en el registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Que la inspección fue recibida por el [REDACTED], veterinario del centro y administrador, quien manifestó conocer y aceptar la finalidad de la Inspección, en cuanto se relaciona con la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por personal técnico de la instalación, resulta que:

GENERALIDADES

- No se detectaron discrepancias con los datos registrales.-----
- La instalación se encontraba ubicada en la planta [REDACTED] en el emplazamiento referido.-----
- La instalación linda en los planos superior e inferior con viviendas y terreno respectivamente.-----
- Estaba disponible el plano de la instalación pero no coincidía con la ubicación



actual del equipo.-----

- Estaba disponible una acreditación del CSN a nombre del Sr. [REDACTED] para dirigir en instalaciones de radiodiagnóstico veterinario.-----

- Estaba disponible 1 dosímetro personal a nombre del Sr. [REDACTED] para el control dosimétrico de la instalación.-----

- Estaba disponible un convenio con el [REDACTED] para la realización de dicho control dosimétrico.-----

- Se disponía de los registros mensuales y el historial dosimétrico de dichos dosímetros.-----

- No estaba disponible ningún contrato escrito con ninguna UTPR.-----

- La UTPR [REDACTED] había realizado el control anual en julio de 2011. No constaba ninguna revisión posterior.-----

- No estaba disponible ningún certificado de conformidad de la instalación.-----

- No estaba disponible el programa de protección radiológica.-----

- No estaba disponible la clasificación del personal.-----

- Estaban disponibles 2 delantales plomados y guantes y protectores tiroideos.---

- Como cuerpo dispersor se utilizó un cuerpo de plástico con una altura de agua de unos 15 cm.-----

- El equipo utilizado por la Inspección para la detección de los niveles de radiación fue uno de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED] n/s 1190.-----

SALA DE RAYOS X

- Dicha sala linda con:

- vecinos
- vecinos
- vecinos
- quirófano

- Disponía de acceso señalizado y controlado.-----

- Se encontraba instalado un equipo fijo de rayos X de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] ° G29007 de 125 kv y 320 mA.-----



CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- El veterinario se situaba junto a la mesa del equipo cuando el animal no se encontraba anestesiado y fuera de la dependencia cuando si lo estaba, siempre provisto de delantal.-----
- Los disparos eran realizados mediante un disparador de hombre muerto con cable de 2,5 m.-----
- Con unas características normales de funcionamiento, se midieron 3 mSv/h a pie de tubo sin delantal plomado y de 150 µSv/h en el mismo lugar tras delantal plomado.-----


DESVIACIONES

- El plano no era actualizado.-----
- No estaba disponible ningún contrato escrito con ninguna UTPR.-----
- La UTPR [redacted] había realizado el control anual en julio de 2011. No constaba ninguna revisión posterior.-----
- No estaba disponible ningún certificado de conformidad de la instalación.-----
- No estaba disponible el programa de protección radiológica.-----
- No estaba disponible la clasificación del personal.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a 3 de septiembre de 2014.

Firmado:

[redacted signature]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

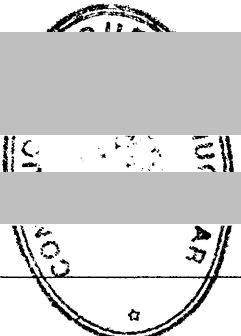



TRAMITE: En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 45 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (Real Decreto 1836/1999, BOE 313 del 31.12.1999 - versión castellana y BOE 1 del 20.01.2000 - versión catalana), se invita a un representante autorizado del Mediavilla i Cia. Veterinària SCP para que con su firma, haga constar, a continuación, las manifestaciones que estime pertinentes

[Redacted signature area]


[Redacted signature area]

Generalitat de Catalunya
Direcció General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial

Número: 0298E/10693/2014
Data: 23/09/2014 12:36:20

Registre d'entrada

Els adjuntem la carta signada i els comuniquem que estem procedint al canvi de titularitat de l'empresa.

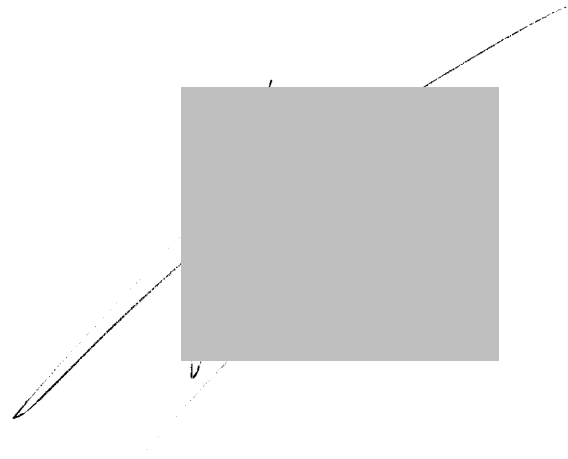

Calella, 19 de Setembre de 2.014