



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, el día treinta de diciembre de 2013 en la instalación de rayos X para diagnóstico médico dental, cuyo titular es D. [REDACTED], [REDACTED], sita en calle [REDACTED], Lorca, Murcia.

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico dental.

Que la Inspección fue recibida por el titular, director de la instalación, quien colaboró con en la Inspección.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

ANO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se encuentra ubicada en un edificio de viviendas, en la dirección antes indicada. _____
- En la instalación se encuentran: un equipo de rayos x para diagnóstico dental intraoral, marca [REDACTED], [REDACTED], con nº de serie: YKYA 298. _____
- La sala dispone de señalización reglamentaria, y existe cartel avisador para embarazadas. _____
- El acceso al gabinete está controlado. _____
- En la instalación se dispone de un delantal plomado. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

- Los niveles de radiación registrados en la instalación referente al equipo [REDACTED] utilizando como elemento de dispersión un recipiente con agua, con la técnica 8 7mA y 60 kV con 0,63 s, son de 0,59 $\mu\text{Sv/h}$ en el puesto del operador, junto a la puerta y 5,89 $\mu\text{Sv/h}$ en el espacio colindante dedicado a Recepción. _

- El titular manifiesta que se realizan 2 o 3 radiografías a la semana. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- El único personal expuesto en la instalación es el titular, que está acreditado para dirigir la misma. _____

CUATRO GENERAL, DOCUMENTACIÓN

El control dosimétrico se refiere a un TLD de solapa, gestionado mensualmente por [REDACTED], aportando como última lectura la correspondiente al mes de noviembre de 2013, sin valores significativos, y correspondiente a los últimos 4 meses. _____

Se exhibe a la Inspección Certificado de conformidad de la instalación emitido por la UTPR [REDACTED] _____

Se exhibe a la Inspección el contrato suscrito con la UTPR [REDACTED] con fecha 10/11/2011. _____

Está disponible el Programa de Protección Radiológica, _____

Se exhibe a la Inspección el Control de Calidad anual de fecha 21/11/2012 y el albarán del parte de trabajo de la última inspección realizada el 25/12/2013, no estando disponible todavía el pertinente informe. ____

- Se exhibe a la Inspección informe anual correspondiente a 2012. _____

DESVIACIONES.

- No está disponible la inscripción de la instalación. _____

- No está disponible el informe de dosis a pacientes. _____

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1105/2013

Hoja 3 de 3



- No está disponible el certificado anual de vigilancia de nivel de radiación. _


Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 20 de enero de 2014.

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL

C.S.N.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de D.   en Lorca, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a continuación, su conformidad o reparos al contenido del Acta.

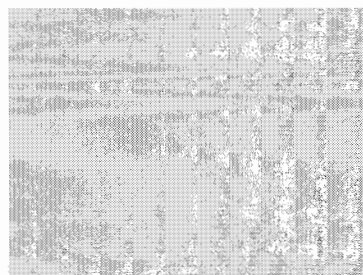

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN-RM/AIN/1/RX-MU/1105/2013** de fecha 30/12/2013, correspondiente a la inspección realizada en Clínica Dental [REDACTED], sita en la calle [REDACTED] en Murcia

D. [REDACTED], representante de la instalación adjunta un ANEXO DE REPAROS o alegaciones al contenido de la misma,

El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Se acepta el justificante de la inscripción de la instalación de rayos X, no aportando subsanación de las otras dos desviaciones.

-El comentario o alegación modifica el contenido del acta

Murcia, 25 de febrero de 2014

