

ACTA DE INSPECCION

[REDACTED], Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, el día once de diciembre de 2015 en la instalación de rayos X para diagnóstico dental, cuyo titular es D. [REDACTED] López, NIF: [REDACTED], sita en [REDACTED] - 30430 - CEHEGÍN (Murcia).

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico dental, cuya última inscripción registral es de 09/01/2013, con nº de inscripción IR/MU-1134.

Que la Inspección fue recibida por el titular, acreditado para dirigir este tipo de instalaciones de rayos X.

Que dicho titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se encuentra ubicada en la planta primera de un edificio de viviendas, en la dirección antes indicada, existiendo por encima una vivienda y por debajo un local comercial.
-
- En la instalación se encuentra un equipo para radiología dental intraoral, [REDACTED] 2100 con nº de serie YGYA248, así como un equipo para ortopantomografía [REDACTED] con nº de serie CJE403263/986872/8D01138. Cada equipo se encuentra ubicado en su correspondiente sala. Respecto este

último equipo, manifiesta el titular que se encuentra averiado y que está a la espera de que la EVAT le envíe un presupuesto para la reparación.


-
- La instalación dispone de control de acceso y de la señalización reglamentaria, pero no de cartel de aviso a embarazadas.
-
- En la instalación se dispone de un delantal plomado.
-

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

Los niveles de radiación registrados en la instalación utilizando como elemento de dispersión una botella de plástico con agua, utilizando la técnica mas frecuente, son los siguientes:

Gabinete intraoral:

kV	mA	Seg.	Puesto	µSv/h
60	7	0,4	Operador (en sala del equipo de ortopantomografía, pulsador de pared). Equipo [REDACTED]	0,57
60	7	0,4	Sala de espera. Equipo [REDACTED]	1,4
60	7	0,4	Gabinete contiguo. Equipo [REDACTED]	0,6

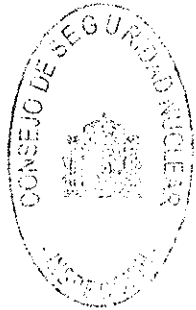

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- No se aporta acreditación para dirigir la instalación.
- No se exhiben acreditaciones de operador.
-

CUATRO. DOCUMENTACIÓN

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1134/2015

Hoja 3 de 4

- Se exhibe a la Inspección el documento de Registro de la instalación con los aparatos en ella existentes.
- El control dosimétrico se refiere a un dosímetro [redacted] de solapa utilizado, gestionado por [redacted] hasta julio de 2014 y por [redacted] desde junio de 2015. Desde agosto de 2014 solo hay informes de 3 meses (junio, julio y agosto, todos ellos de 2015). Además, en agosto de 2015 se indica: "dosímetros leídos: 0 (cero)"

Dispone de Control de Calidad anual realizado con fecha 10/07/2015 por la UTPR [redacted] no señalando anomalías

Aporta certificado anual de vigilancia de nivel de radiación ambiental, de fecha y por la UTPR iguales que en el caso anterior, sin valores inadmisibles.

Se exhibe contrato con la UTPR [redacted], pero sin fecha.

- Dispone de Programa de Protección Radiológica.
- No dispone de Certificado de conformidad en vigor, siendo de fecha 21/02/2013 (de la UTPR [redacted]). Aporta escrito de julio de 2015, de [redacted] requiriendo al titular documentos/datos para realizar dicho certificado.

No consta el envío al CSN del Informe bienal. Exhibe un escrito sobre el Informe periódico que indica que adjunta la dosimetría de 2012 y que se efectuó el control o revisión en dicho año.

DESVIACIONES

No dispone de cartel de aviso a embarazadas.

No aporta acreditación para dirigir la instalación.

- El control dosimétrico no se realiza mensualmente.
- El contrato con la UTPR, [redacted], no indica fecha.
- No aporta el Certificado de conformidad de la instalación en vigor.
- No acredita el envío al CSN del Informe bienal.



CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1134/2015

Hoja 4 de 4

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 29 de diciembre de 2015.

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL



C.S.N.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita al titular, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a **continuación**, su conformidad o reparos al contenido del Acta.

fmd.

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1134/2015** de fecha 29 de diciembre, correspondiente a la inspección realizada en la instalación de RX para diagnóstico médico, cuyo titular es [REDACTED] sita en [REDACTED] 30430 - CEHEGÍN (Murcia).

El titular de la instalación aporta los días 22/01/2016 y 10/03/2016 los siguientes documentos no aportados antes: diploma del curso para dirigir instalaciones a nombre del titular, certificado de conformidad de [REDACTED] con fecha 06/05/2014, contrato con [REDACTED] firmado con fecha 01/02/2015 y dosimetría de los meses septiembre a diciembre de 2015. Sigue faltando la dosimetría de agosto de 2015 y las desde agosto de 2014 hasta mayo de 2015.

El Inspector que suscribe manifiesta:

Por lo ya indicado se acepta parcialmente las alegaciones y documentos presentados, variando el contenido del acta por quedar subsanadas las desviaciones de la acreditación para dirigir, contrato y certificado de conformidad.

Murcia, 14 de abril de 2016

Fdo. [REDACTED]

Hay documentación aparte

Murcia 7 de Marzo de 2016.

A la atención de [REDACTED]

TITULAR: [REDACTED]

Adjunto documentación solicitada(junto con Acta de Inspección) aunque parte de ella ya fue enviada por correo.

- Acreditación para dirigir instalaciones.
- Control dosimétrico de 2015
- Contrato con [REDACTED] con fecha
- Certificado de conformidad.

No se dispone aún de informe bianual de 2015 que según la empresa se dispondrá de él en breves fechas.

También se han colocado los carteles de aviso a embarazadas.

[REDACTED]

10 - 3 - 2016

[REDACTED]