

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, acompañado por D. [REDACTED] funcionario de la CARM e Inspector en prácticas del CSN, el día veinticuatro de noviembre de 2011 en la instalación de rayos X para diagnóstico veterinario cuyo titular es D. [REDACTED] con NIF: [REDACTED] sita en C/ [REDACTED] Beniel, Murcia.

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el domicilio citado, destinada a radiodiagnóstico veterinario, cuya última inscripción registral es de 7 de marzo de 1997, realizada a nombre de D^a [REDACTED] y D^a [REDACTED] y su n^o de inscripción es IR/MU-1630.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Veterinario y Director de la instalación y actual titular.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:


OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se encuentra ubicada en un bajo comercial de edificio de viviendas. _____
- El único equipo de rayos X existente es un [REDACTED] con tubo [REDACTED] n^o s. 10516. El accionamiento del equipo es por pedal. _____

- La sala está separada del público y tiene acceso controlado a través de despacho de la consulta, estando rodeada de dependencias de la clínica veterinaria. _____
- La instalación dispone de la señalización reglamentaria. _____
- Se disponen de dos delantales, collarines plomados. _____
- La Inspección verifica el procedimiento utilizado por el operador para protegerse de la radiación, al realizar los disparos con el equipo de rayos X. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

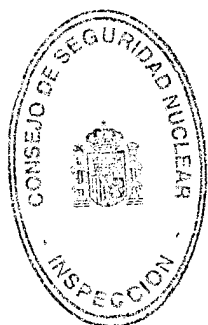

- Se realizan dos disparos, mediante pedal, uno con la técnica 60 kV, 80 mA y 0,08 s, sobre botella de agua registrándose fuera de la sala junto a la puerta 1,98 μ Sv/h, y el segundo, con la técnica 70 kV 70 mA 0,08s, sobre la misma botella, registrándose por el exterior de la pared, fondo radiológico natural. _____
- Se realizan unas 4 radiografías al mes. _____

TRES GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se verifica la acreditación del titular para dirigir la instalación. _____
- La inspección comprueba el control de dosimetría personal para una sola persona correspondiente a octubre de 2011, realizado por el _____, sin valores significativos. _____

DESVIACIONES

- La instalación está inscrita a nombre distinto del actual titular. _____
- No dispone de Programa de Protección Radiológica. _____
- No hay contrato con la UTPR citada con fecha 14/2/2011. _____
- No está disponible el certificado de vigilancia de radiación. _____
- No está disponible el certificado de conformidad de la instalación. _____

- No consta la remisión al CSN del último informe anual. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a cinco de diciembre de 2011.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C. S. N.

Fdo.: _____

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de D. _____ de Beniel, Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a continuación, su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*Las desviaciones están siendo corregidas por la empresa _____
exceptuando el último punto, que harán un Establecimiento del estado
de referencia inicial.
Les envío copia del Contrato, a la espera de que _____ me envíe
el resto de la documentación y se la envíe.*

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN-RM/AIN/1/RX-MU/1360/2011** de fecha 24 de noviembre de 2011, correspondiente a la inspección realizada en la Clínica Veterinaria San Bartolomé, sito en la [REDACTED] de Beniel, Murcia

D. [REDACTED] titular y representante de la instalación adjunta un ANEXO DE REPAROS o alegaciones al contenido de la misma,

El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Se acepta el comentario

-El comentario o alegación modifica el contenido del acta en el sentido que aporta la subsanación a la desviación referente a la disponibilidad de contrato de prestación de servicios con UTPR, al aportar este. El resto de desviaciones quedan por subsanar, debiendo ser comprobado mediante el informe bienal correspondiente.

Murcia, 9 de enero de 2012

Fdo. [REDACTED]