



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día tres de noviembre de dos mil diez en el CENTRO ASISTENCIAL PORTO CARRERO, cuyo titular es el mismo, de CIF [REDACTED] y que se encuentra ubicado en la [REDACTED] en Almería (C.P.-04002).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde 1997.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED] representante legal de la Sociedad titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación consta de 2 equipos, distribuidos del modo siguiente:
 - Sala 1.- Equipo intraoral [REDACTED] con n^o/s 14961
 - Sala 2.- Equipo intraoral [REDACTED] con n^o/s 4224. _____
- Las dos salas colindan entre sí y estaban señalizadas con trébol gris, y disponían de acceso controlado. Ninguna de las salas estaba plomada.
- Disponían de delantal, collarín tiroideo y guantes plomados. _____

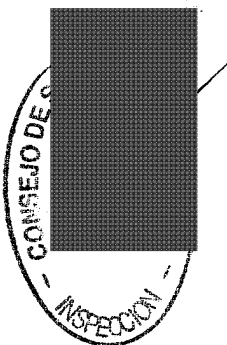



DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN


- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma de agua, en la sala nº 1, se hicieron medidas de tasas de dosis en la posición del operador, obteniéndose valores similares al fondo natural. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- El Director es D^a. _____ que disponía de Acreditación del CSN para ello. _____
- Se disponía de 1 dosímetro TL personal, a nombre de la Directora, cuyas lecturas son efectuadas por el _____. Los valores de los registros dosimétricos a fecha de 2010 eran de 9'06 mSv en 5 años. En los últimos 12 meses había 6 meses en los que no se había enviado el dosímetro para su lectura. _____
- Según manifestaron no hay otro personal expuesto a radiaciones aparte de la propia Directora. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN


- Estaba disponible un ejemplar del Programa de Protección Radiológica, elaborado por _____
- Se disponía de un contrato escrito con la UTPR _____ de fecha 2010.
- Se disponía de Informe de Dosis a Paciente, firmado por un radiofísico.
- No se disponía de registro de incidencias o averías porque, según manifestaron, no las ha habido. _____
- Se disponía de los resultados del último control de calidad, realizado por D _____ técnico de _____, en 3 de marzo de 2010. En él no figuran anomalías _____

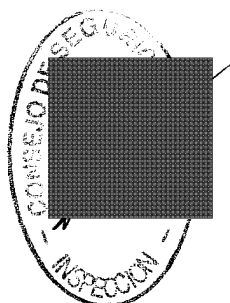

DESVIACIONES

- No disponía de carteles de aviso a embarazadas, incumpléndose por tanto el artículo 9.1 del Real Decreto 1976/1999 sobre criterios de control de calidad en radiodiagnóstico. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 35/2008 por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a once de noviembre de dos mil diez.

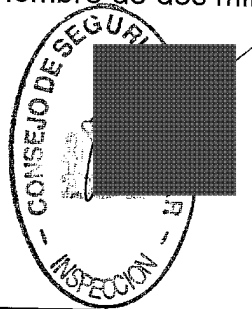

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 35/2008 citado, se invita a un representante autorizado del Centro **"CENTRO ASISTENCIAL PORTO CARRERO" (Almería)** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*Acta enviada (registro de Salida de 12/11/2010) y aún
no contestada a 4/3/2011.*

