

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1170/2015

Hoja 1 de 4

ACTA DE INSPECCION

█ Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, el día quince de diciembre de 2015 en la instalación de rayos X para diagnóstico dental, cuyo titular es CLINICA DE PERIODONCIA █, █ sita en C/ █ █ █ █ - 30004 - MURCIA .

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico dental, cuya última inscripción registral es de 20/01/2014, con nº de inscripción IR/MU-1170.

Que la Inspección fue recibida por D^a █, administrativa,.

Que dicho titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

D. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

La instalación se encuentra ubicada en la planta segunda de un edificio de viviendas, en la dirección antes indicada, existiendo por encima y por debajo sendas oficinas.

- En la instalación se encuentran dos equipos para radiología dental intraoral, un █ con nº de serie 6812066-870641 y un █ nº de serie █ 0544/105041. Cada equipo se encuentra ubicado en su correspondiente sala.

- La instalación dispone de control de acceso y de la señalización reglamentaria. Existe cartel de aviso a embarazadas solo en el equipo citado en último lugar.

-

- En la instalación se dispone de un delantal plomado y un protector tiroidal.

-

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

Los niveles de radiación registrados en la instalación utilizando como elemento de dispersión una botella de plástico con agua, utilizando la técnica mas frecuente, son los siguientes:

Gabinetes intraorales:

kV	mA	Seg.	Puesto	µSv/h
70	8	0,04	Operador (pasillo, pulsador de cable). Equipo n/s 6812066	0,73
70	8	0,04	Gabinete contiguo. Equipo n/s 6812066	19,3
70	8	0,08	Operador (pasillo, pulsador de pared). Equipo n/s XAPB 0544	0,11
70	8	0,08	Gabinete contiguo. Equipo n/s XAPB 0544	1,97



TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- Hay dos acreditaciones para dirigir u operar la instalación.
- Hay también una acreditación de operador.


-

CUATRO. DOCUMENTACIÓN

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1170/2015

Hoja 3 de 4

- Se exhibe a la Inspección el documento de Registro de la instalación con los aparatos en ella existentes.
- El control dosimétrico se refiere a dos dosímetros TLD de área utilizados, gestionados por [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] comprobando la inexistencia de valores significativos desde enero de 2014 a noviembre de 2015, pero no aporta el protocolo de asignación de dosis.
- Dispone de Control de Calidad anual realizado con fecha 24/11/2015 por la UTPR [REDACTED] no señalando anomalías
- Aporta certificado anual de vigilancia de nivel de radiación ambiental, de fecha y por la UTPR iguales que en el caso anterior, sin valores inadmisibles.
- Se exhibe contrato con la UTPR [REDACTED] de 28/10/2014.
- Dispone de Programa de Protección Radiológica.
- El Certificado de conformidad de la instalación lo realizó la UTPR [REDACTED] el 01/03/2011.

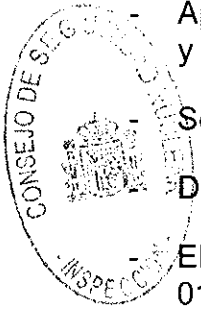

SVIACIONES

- No existe cartel de aviso a embarazadas en uno de los equipos.
- No aporta el protocolo de asignación de dosis de los dosímetros de área.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de



CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1170/2015

Hoja 4 de 4

Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 29 de diciembre de 2015.

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C. S. N.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1650/1999 citado, se invita al titular, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a **continuación**, su conformidad o reparos al contenido del Acta.

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1170/2015** de fecha 29 de diciembre, correspondiente a la inspección realizada en la instalación de RX para diagnóstico médico, cuyo titular es CLINICA DE PERIODONCIA DR. [REDACTED] en C/ [REDACTED] - 30004 - MURCIA .

El titular de la instalación aportó el 12/02/2016 el protocolo de asignación de dosis a partir de la dosimetría de área.

El Inspector que suscribe manifiesta:

Se acepta la documentación aportada por el titular, variando el contenido del acta, en el sentido de que queda subsanada la desviación sobre el protocolo de asignación de dosis.

Murcia, 14 de abril de 2016

[REDACTED]