

SN



CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL
ENTRADA 20990
Fecha : 16-10-2007 13:09

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día doce de septiembre de dos mil siete en la CLÍNICA DENTAL DEL DR. OLIVER HOUDUSSE, de CIF [REDACTED] y que se encuentra en la [REDACTED] (Murcia).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que figura inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde fecha 19/06/2006.

Que acompañó al inspector D. [REDACTED]. Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear en la Región de Murcia

Que la Inspección fue recibida por el titular de la instalación que acepto la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.


Que el titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se componía de un solo equipo dental intraoral, de la marca y modelo [REDACTED] con nº /s 312849/34470. El equipo está instalado en una sala con la señalización del trébol reglamentario.

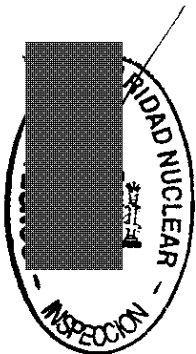

- Era visible un cartel de aviso a embarazadas. Disponía de un delantal plomado. _____
- El operador se ubica en el exterior de la sala, accionado un pulsador de pared. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma de agua situado en la posición del paciente, en modo RadioVisioGrafía en la ubicación del operador se medía una tasa de dosis inferior a 1 μ Sv/h. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- D. [REDACTED] dispone de Acreditación para Dirigir. _____
- Se efectúa la vigilancia dosimétrica del Sr. [REDACTED] única persona considerada como trabajador expuesto, mediante disimetría personal, siendo los valores de los registros dosimétricos actualizados, a agosto de 2007, no significativos en dosis acumulada anual. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN


- El último control de calidad fue realizado con fecha 28/02/2007. _____
- Han enviado al CSN el último informe anual relativo a 2006. _____

DESVIACIONES





Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintiocho de septiembre de dos mil siete.

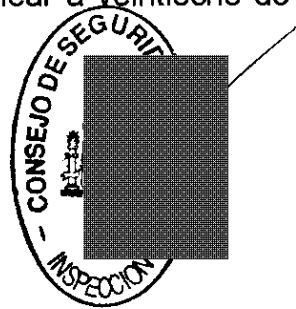

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a D. [REDACTED] (Puerto de Mazarrón), para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Puerto de Mazarrón

8 del octubre de 2007

[REDACTED]

[REDACTED]