

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 1 de 2

ACTA DE INSPECCIONº

D. [REDACTED]. Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día doce de septiembre de dos mil trece, en **LA FONTE ARDENNAISE ESPAÑA, SL.**, sita en la [REDACTED] Guíllenla, Sevilla.


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiografía industrial, cuya autorización, fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en fecha 16 de julio de 2013.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED] Responsable de Calidad y Medio Ambiente y Supervisora, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En la instalación radiactiva señalizada, provista de acceso controlado, de acuerdo con el plano presentado en la solicitud, se encontraba instalado un equipo de rayos X, de la firma [REDACTED] con generador [REDACTED] n/serie 0360313-0370313 y tubo de rayos X n/serie 314949, en el interior de una cabina plomada.-----
- La citada cabina dispone de señalización luminosa de operación, así como cierre mecánico, mediante llave solidaria con la llave del pupitre

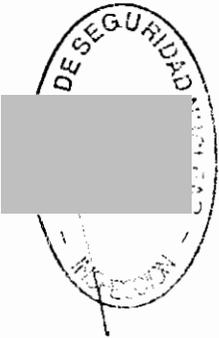

de control, que impide la acción simultánea de apertura de puerta y disparo del equipo de rayos X, así como mecanismo interior de interrupción de la operación (seta), disponiendo de otro el pupitre de control.-----

- Disponen de un equipo para la detección y medida de la radiación, n/serie 75236, calibrado en la en fecha 2013.-----
- Disponen de Dosímetro de solapa TLD, en la actualidad sin registro dosimétrico.-----
- En las condiciones de operación de 320 kV, 12 mA, con el haz de radiación dirigido al suelo, los niveles de radiación medidos, en: Puerta de acceso a la cabina, pared de la cabina colindante con pupitre de control, resto de las paredes de la cabina y en la zona colindante con la parte superior de la cabina, en la zona de vestuarios, fueron los correspondientes al fondo radiológico ambiental.-----
- Fue comprobado el correcto funcionamiento del interruptor de parada (seta), sito en el pupitre de control.-----
- Disponen de Licencia de Supervisora, pendiente de aplicación a la instalación.-----
- Disponen de Diario de Operación, de ref. 88/13.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980(reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999(modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dieciocho de septiembre de dos mil trece.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1, del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "LA FONTE ARDENNAISE ESPAÑA, SL." para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

COMUNICADO POR FAX EL DÍA 17/09/2013 QUE OPERARA EN LA INSTALACION CON LICENCIA DE SUPERVISORA OPERATIVA CON IRA-3251.

EN GUILLENA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013



CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

DILIGENCIA

En relación con el Acta de referencia CSN/AIN/01/IRA/ 3251/13 de fecha doce de septiembre, correspondiente a la inspección realizada en La Fonte Ardennaise España, SL., Guillena (Sevilla)

El Inspector que la suscribe, declara con relación al comentario formulado, en el anexo al trámite de la misma, que.

Se acepta el contenido

Madrid, 30 de septiembre de 2013

Fdo.

