

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

CSN/AIN/01/RX/M-3554/09

Hoja 1 de 3

ENTRADA 8996

Fecha: 15-04-2009 13:49

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintisiete de marzo de dos mil nueve en la CLINICA DENTAL DENTICOR SL, cuyo titular es el mismo, de CIF [REDACTED] y que se encuentra en la calle [REDACTED] en Madrid (C.P.-28047).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid desde fecha 10/03/2009.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] director de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación tiene 2 equipos instalados en sendas salas. Uno de ellos es intraoral, de marca [REDACTED] y el otro panorámico, de marca [REDACTED]. La sala del panorámico se encontraba plomada en todos sus colindamientos horizontales. _____
- Eran visibles carteles de aviso a embarazadas. Había señalización de trébol reglamentaria. _____

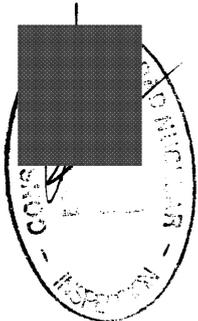

DIGITALIZADO 3RO

CSN



CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- Disponían de delantal plomado. _____
- El equipo intraroal dispone de Radiovisiografía y el panorámico es digital. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN

- Mientras se efectuaban disparos con el equipo intraroal se midieron tasas de dosis similares al fondo radiológico natural en la ubicación del operador. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Según se manifestó, la única persona que dirige la instalación y que opera los equipos es D. _____ que dispone de Acreditación para Dirigir. _____
- Se disponía de 1 dosímetros TL personal. Los valores de los registros dosimétricos actualizados eran de < 1 mSv/5 años. _____


CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se disponía de los resultados de un control de calidad realizado por la UTPR _____ en junio de 2008. En él no figuran anomalías _____

DESVIACIONES


- No se detectaron. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes,

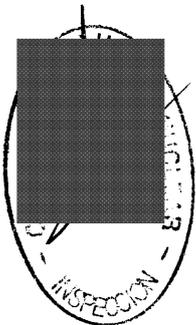




se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a treinta y uno de marzo de dos mil nueve.

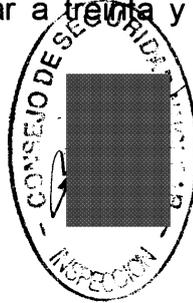

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del Centro **"CLINICA DENTAL DENTICOR SL" (Madrid)** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste conformidad o reparos al contenido del Acta.



13.4.09.

