

CSN



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintiocho de noviembre de dos mil ocho en la CLÍNICA LA FRATERNIDAD MUPRESA, cuyo titular es MUTUA LA FRATERNIDAD MUPRESA MATEPSS N^a 275, de CIF [REDACTED] y que se encuentra en la calle [REDACTED] de Alcorcón, en Madrid (C.P.-28923).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid desde fecha 03/03/2008.

Que la Inspección fue recibida por D^a [REDACTED], Delegada del Centro y D^a [REDACTED], directora de la instalación radiactiva, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación tiene 1 único equipo, instalado en una sala plomada en paredes y puertas. La sala se encontraba señalizada con el trébol reglamentario y disponía de señales luminosas de funcionamiento sobre la puerta de acceso. _____
- El equipo instalado era de la marca y modelo [REDACTED] _____

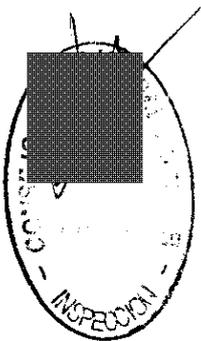

- Disponían de carteles de aviso a embarazadas. _____
- Disponían de 2 delantales y 1 collarín plomados. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN


- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma de agua se midieron tasas de dosis similares al fondo radiológico ambiental tanto en la ubicación del operador (en cabina con visor plomado) como en la sala de rehabilitación adyacente. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Según manifestó la Dra. [REDACTED] ella lleva ejerciendo la función de directora de la instalación desde octubre de 2007. Disponía de Acreditación para ello. _____
- Los tres operadores del equipo disponían asimismo de Acreditación. ____
- Se disponía de 2 dosímetros TL personales y, según se manifestó, han solicitado recientemente otros 2. Los valores de los registros dosimétricos actualizados son de < 2 mSv/año. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN


- El Diario de Operación estaba actualizado y sin incidencias anotadas. __
- Disponían del informe de resultados de una revisión realizada por la UTPR [REDACTED] en fecha 27-09-2007. En él no se reseñan anomalías. ____
- Se ha recibido en el CSN el informe anual correspondiente al año 2007, remitido por la UTPR [REDACTED] en formato electrónico. _____

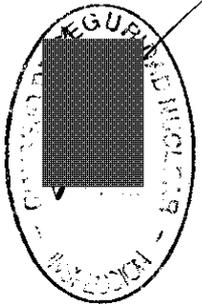



DESVIACIONES

- No se detectaron. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a uno de diciembre de dos mil ocho.

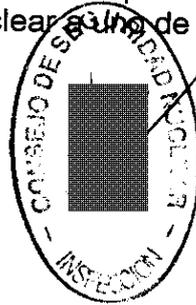

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del Centro **"CLINICA LA FRATERNIDAD MUPRESPA" (Alcorcón)** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

 Como Delegada del centro certifica su conformidad en el contenido del acta, excepto en la fecha en la que la Doctora  viene desempeñando la función de Directora de la instalación, siendo la Cometa Noviembre del 2008 hasta entonces el director era el Doctor 

En Alcorcón a 17/12/08

