



ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), acreditado como inspector.

CERTIFICA: Que se personó, el día veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, en el **HOSPITAL CAMPUS DE LA SALUD. COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA**, sito en [REDACTED] Granada.



La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a: Diagnóstico y tratamiento médico, cuya autorización vigente, fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en fecha 29 de julio de 2016.

La Inspección fue recibida por, D. [REDACTED], Jefe de Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- La instalación radiactiva, señalizada, provista de acceso controlado y extinción de fuego, se encontraba ubicada en el sótano -1, del emplazamiento referido. _____
- La instalación radiactiva dispone de blindajes en puertas, paredes y visor acristalado de la sala que alberga la cámara SPECT-CT. _____
- En la sala destinada a gammacámara, se encontraba instalado un equipo de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED], nº/de serie 27112, exhibiendo la declaración de conformidad, CE. _____
- En el momento de la inspección no se disponía de material radiactivo para diagnóstico, así como de fuentes radiactivas encapsuladas. _____

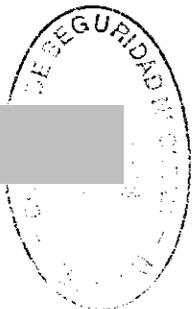




- En el momento de la inspección disponían de un fuente de verificación de Co-57 de 740 MBq. de actividad en origen, marca [REDACTED] de ref. BM01L2016036101, exhibiendo el certificado correspondiente. _____
- Disponen de medios adecuados para la manipulación y almacenamiento de material y residuos radiactivos. _____
- Según se manifestó se realizan la gestiones oportunas, para que tanto las licencias de operación como la dosimetría personal, pueda utilizarse simultáneamente en todas las instalaciones radiactivas del Complejo Hospitalario de Granada (II: RR: 0744, 0413 B, 3357). _____
- Consta se haya dado cumplimiento al punto I.3, anexo-I, IS-28, referente al informe anual de la instalación. _____
- Según se manifestó la instalación no funciona en la actualidad. _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado, en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a seis de marzo de dos mil diecisiete.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1, del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "HOSPITAL CAMPUS DE LA SALUD-MN" para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

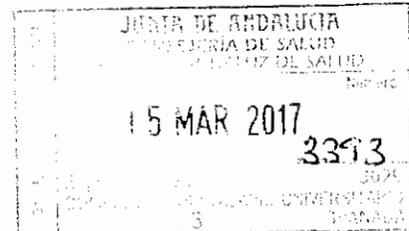

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
CALLE DE PEDRO JUSTO DORADO
DELLMANS Nº 11
28040 MADRID

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 4531


Fecha: 24-03-2017 09:22

Granada, a 14 de Marzo de 2017

Les remitimos firmadas las copias de las Actas de la Inspección efectuada al Servicio de Protección Radiológica de los Hospitales San Cecilio y del Campus de la Salud de Granada, realizadas los días 21 y 23 de Febrero de 2017, y cuyas referencias son las siguientes:

- CSN/AIN/02/IRA/3357/17
- CSN/AIN/03/IRA-3302/17
- CSN/AIN/24/IRA-1935/17
- CSN/AIN/42/IRA-0413 B/17
- CSN/AIN/43/IRA-0413 A/17

Atentamente,



[Redacted]
Jefe Sº de Radiofísica
Hospital Univ. San Cecilio
CNP: 00/0034328/87