

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día cinco de noviembre de dos mil ocho en la CLINICA DENTAL DE D. [REDACTED] [REDACTED] cuyo titular es él mismo, de NIF [REDACTED] y que se encuentra en la [REDACTED] de Ronda, en Málaga (C.P.-29400).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde fecha 22/11/2007

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] titular de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación consta de 1 único equipo dental instalado en una sala no plomada y reglamentariamente señalizada. _____
- El equipo instalado era un dental intraoral de la marca y modelo [REDACTED] [REDACTED] con marcado CE₀₄₃₄. _____

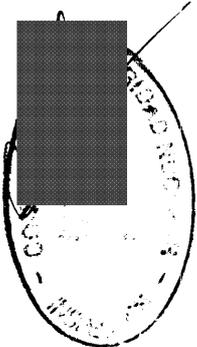

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 23284

Fecha: 10-12-2008 17:05



- Disponían de carteles de aviso a embarazadas. _____
- Disponían de 1 delantal y 1 collarín plomados. _____
- El equipo utiliza RadioVisioGrafía. _____
- La sala de espera no colinda con la sala del equipo de rayos X. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN


- Mientras se efectuaban disparos de 0'7 segundos sobre un fantoma de agua, se midió en la ubicación del operador (fuera de la sala) una tasa de dosis máxima de 60 μ Sv/h. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Según se manifestó, el titular es el único operador de la instalación. Dispone de Acreditación para Dirigir. _____
- El titular dispone de un TLD personal cuyas lecturas actualizadas son de 0'00 mSv/5 años. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Según manifestaron, se realizan entre 5 y 10 radiografías semanales. _
- El Diario de Operación, entregado por la UTPR [REDACTED] contenía las anotaciones relativas a las revisiones realizadas al equipo. Se adjunta, como anexo 1, copia de la página de interés. _____
- Se mostró el informe relativo a la revisión de la instalación realizada en fecha 22-05-2008 por parte del técnico de [REDACTED] _____
- Según manifestó el titular, en ambas ocasiones el técnico que estuvo era un hombre, aunque desconoce el nombre del que estuvo en la visita del día 4-07-2008, que se efectuó con fines de Declaración. En ningún caso recuerda que fueran acompañados de una mujer. _____

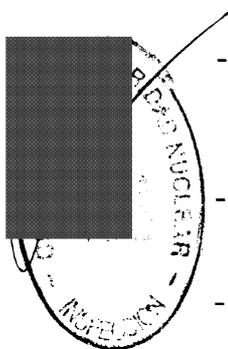


SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

DESVIACIONES

- No se detectaron. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

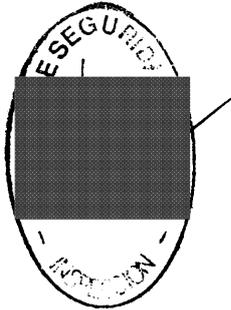

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "CLINICA DENTAL DR. [REDACTED]" (Ronda) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



Ronda (Telépe) 5 de Diciembre de 2008