

**SN**CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR**ACTA DE INSPECCIÓN**

D. [REDACTED], Inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

**CERTIFICA:** Que se ha personado los días veintisiete y veintiocho de febrero de dos mil trece en el **HOSPITAL CENTRAL DE ASTURIAS**, sito en [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] de Oviedo (Asturias).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar unas instalaciones radiactivas destinadas a uso médico ubicadas en el emplazamiento referido.


Que la última autorización de la instalación de Braquiterapia y Terapia Metabólica, relativa a la puesta en marcha fue realizada por resolución de la Consejería de Economía de fecha 18 de mayo de 1998.

Que la inspección fue recibida por doña [REDACTED] [REDACTED] Jefa del Servicio de Física Médica y Protección Radiológica (FM y PR) quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La instalación, señalizada y provista de acceso controlado, está ubicada en la [REDACTED] del edificio A del Hospital General y consiste en seis habitaciones, tres de ellas destinadas a braquiterapia convencional y diferida pulsada y las otras tres para

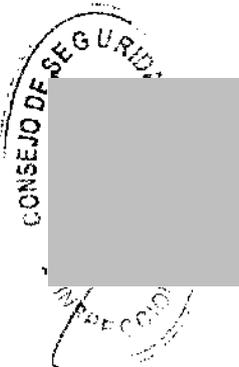

**SN**CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

terapia metabólica. Junto a la puerta dispone de un monitor de radiación [REDACTED].-----

Las habitaciones número 156 y 158 disponen de monitores de radiación [REDACTED] modelo [REDACTED] números 341 y 346 y están conectadas a un sistema de tratamiento de residuos radiactivos líquidos de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] número 19, que se encuentra en un recinto aislado, señalizado y provisto de acceso controlado y dosimetría de área (cinco), que es revisado semestralmente por la firma suministradora.

Que la habitación número [REDACTED] se destina a tratamientos con Sm-153, realizándose la eliminación de los residuos radiactivos líquidos vertiéndolos al sistema de las habitaciones [REDACTED].-----

El Servicio de Física Médica realiza medidas periódicas de radiación y contaminación en diferentes puntos de la instalación.-----

Disponen de Diario de Operación, siete licencias de Supervisor y cinco de Operador en vigor.-----

La revisión de los registros dosimétricos al mes de diciembre de 2012, correspondientes a ocho usuarios, no presentan valores significativos.-----

Consta la presentación del informe anual correspondiente a 2011.---

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a cinco de marzo de dos mil trece.

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **HOSPITAL CENTRAL DE ASTURIAS** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME: Oviedo, 11 de Marzo de 2013

Fdo. [REDACTED]