

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintiseis de noviembre de dos mil nueve en la Clínica Dental "Delicias Dental", cuyo titular es "Delicias Dental, SL", con NIF [REDACTED] y que se encuentra [REDACTED] en Madrid (C.P.-28045).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid desde 29/04/20001.

Que la inspección fue recibida por D^a [REDACTED] directora de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación consta de 3 equipos de radiografía dental, de la marca y modelo siguientes:
- Sala 1: intraoral [REDACTED]
 - Sala 2: Intraoral [REDACTED]
 - Sala 3: panorámico [REDACTED]

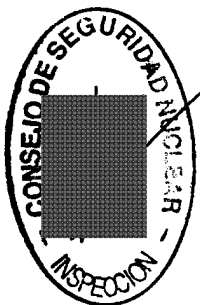

Madrid, 11/12/2009

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL
ENTRADA 22560
Fecha: 15-12-2009 13:24


- Las salas disponen de señalización reglamentaria y la del equipo panorámico se encontraba plomada en sus colindamientos laterales y puerta. Los tres equipos colindan con la sala de espera. _____
- En las tres salas la ubicación del operador está en el exterior de la sala, accionando pulsadores de pared. _____
- Los equipos no disponían de Radiovisiografía. _____
- En la sala del equipo panorámico no hay posibilidad de ver al paciente durante las exploraciones. _____
- Disponen de delantales plomados. _____
- Eran visibles carteles de aviso a embarazadas. _____


DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN

- Mientras se efectuaban disparos con cada uno de los equipos se midieron las siguientes tasas de dosis:
 - Sala 1.- 90 $\mu\text{Sv/h}$ en la ubicación del operador y 16 $\mu\text{Sv/h}$ en la sala de espera
 - Sala 2.- 0 $\mu\text{Sv/h}$ en la ubicación del operador y 7 $\mu\text{Sv/h}$ en sala de espera
 - Sala 3.- 0 $\mu\text{Sv/h}$ en la ubicación del operador. _____
- Según manifestaron, entre los dos equipos intraorales se realiza un promedio de 15 radiografías por semana. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Según manifestaron, la única persona que opera los equipos es D^a _____, que dispone de Acreditación para Dirigir. _____
- Disponían de 1 dosímetro personal, leído por _____ cuyas lecturas actualizadas eran de 3'72 mSv/5 años. _____

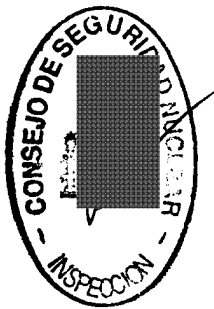


Madrid, 11/12/2009


CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Disponían de un contrato de servicios con la UTPR [REDACTED] suscrito en fecha 8/09/2009. _____
- Disponían de los resultados de una visita técnica realizada por D. [REDACTED] [REDACTED] técnico de la UTPR [REDACTED] en fecha 08/09/2009. En la hoja de conclusiones del informe de esta visita no se hacen recomendaciones especiales a la instalación. _____

DESVIACIONES

- No se detectaron. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 35/2008 por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a tres de diciembre de dos mil nueve.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 35/2008 citado, se invita a un representante autorizado del Centro **"DELICIAS DENTAL SL"** (Madrid) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[REDACTED]

Madrid, 11/12/2009