

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEARACTA DE INSPECCIÓN

Don [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para la Comunidad Foral de Navarra,

CERTIFICA:


Que se ha personado el día diecinueve de mayo de dos mil nueve, en las instalaciones de la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN), sitas en la calle [REDACTED] de CORDOVILLA (Navarra).-----

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva de segunda categoría, destinada a radiografía industrial, ubicada en el emplazamiento referido, cuya última autorización de modificación fue concedida por el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo del Gobierno de Navarra con fecha 1 de septiembre de 2004, la cual dejaba sin efecto a las anteriores autorizaciones.-----

Que la inspección fue recibida por D. [REDACTED] Ingeniero de la AIN y Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien manifestó conocer y aceptar la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.-----

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el Acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.-----

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal antes citado, resulta que:

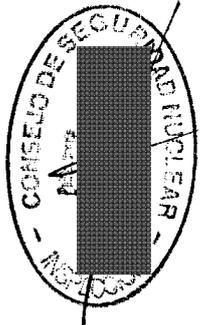

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- La instalación radiactiva consistía en un recinto blindado, ubicado en la planta baja, que colindaba en su mismo plano con un pasillo, el laboratorio de Termografía, un cuarto de revelado, y el pasillo con la puerta de acceso.-----

- En el recinto blindado, dotado de señalización luminosa y de mecanismo de interrupción de irradiación en puerta, se encontraba instalado un equipo de Rayos X, de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED], de 300 KV y 5 mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente, con n° de serie 74239/2.-----

- En la misma dependencia se encontraban almacenados los siguientes equipos móviles:

- * Un equipo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] de 200 KV y 5 mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente, con n° de serie 75349/1.
- * Un equipo de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED] de 200 KV y 4.5 mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente, con n° de serie 85079.-----


- Estaban disponibles los certificados y documentos exigidos en la especificación 15ª de la autorización antes citada.-----

- Los equipos antes citados disponían de sus placas de identificación exteriores con la información exigida en la especificación 24ª de la autorización antes citada.-----

- La instalación se encontraba señalizada, de acuerdo con el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, disponiendo de medios para establecer un acceso controlado.-----

- Disponen de la señalización necesaria para las operaciones con los equipos fuera de la instalación radiactiva.-----

- Semestralmente el Supervisor y el Operador realizan una revisión técnica de los equipos, emitiendo el correspondiente informe.-----

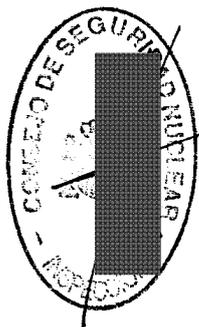

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- En las condiciones de operación de 200 KV y 5 mA del equipo modelo [REDACTED] P, las tasas de dosis medidas fueron las correspondientes al FONDO NATURAL, tanto en paredes como en el puesto de operación junto al generador. Que en contacto con la puerta de acceso la tasa de dosis fue de 12 μ Sv/h.-----

- Disponen de los siguientes equipos para la detección y medida de la radiación:

- * Un dosímetro de lectura directa, de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED] ID, con nº de serie 0075, calibrado por la [REDACTED] en fecha 21/4/09.
- * Un dosímetro de lectura directa, de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] 100, con nº de serie 102477, calibrado por la [REDACTED] en fecha 23/4/09. Que disponían de un programa para la calibración y verificación de dichos equipos.-----


- Estaba disponible y en vigencia una Licencia de Supervisor y otra de Operador.-

- Efectúan el control radiológico de los trabajadores profesionalmente expuestos (el Supervisor y el Operador) mediante el uso de dos dosímetros personales de termoluminiscencia, procesados por el [REDACTED] I de [REDACTED] (Madrid), registrándose las dosis recibidas.-----

- Estaban disponibles los certificados de los reconocimientos médicos anuales del Supervisor y del Operador expedido por el Servicio de Vigilancia de la Salud [REDACTED]. Que, según se manifestó, el personal con licencia es el único clasificado como profesionalmente expuesto y en la categoría "B".----

- Estaba disponible el documento justificativo de que el personal de la instalación había recibido el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia. Que la instalación había implantado el Programa de Formación bienal para los trabajadores expuestos.-----

- La instalación había implantado las exigencias recogidas en la instrucción IS-18.-----

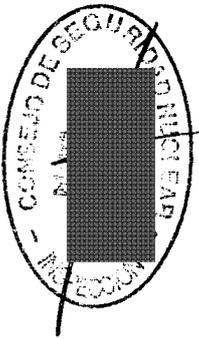



- Estaban disponibles cuatro Diarios de Operación, uno donde constan los desplazamientos de los equipos móviles, y uno específico para cada equipo de rayos X, debidamente diligenciados y cumplimentados.-----

- Habían remitido al C.S.N. y al Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra el Informe Anual de actividades correspondiente al año 2008.---

- Disponían de extintores de incendios en las proximidades del recinto blindado.--

DESVIACIONES:

- No haber remitido al C.S.N. el Plan de Emergencia tras su modificación por haber incorporado las exigencias recogidas en la instrucción IS-18.-----

Que con el fin de quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1836/1999 (modificado por el Real Decreto 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y las referidas autorizaciones, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Pamplona y en la sede del Instituto de Salud Pública, a diecinueve de mayo de dos mil nueve.

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN), para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Manifiesto mi conformidad con la presente acta y que en breve se procederá a la modificación del PLAN DE EMERGENCIA y a su posterior envío al C.S.N. y para que conste a los efectos oportunos firmo esta manifestación

Cordoba a veintidos de mayo de dosmil nueve

Fdo: [Redacted]