

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día quince de febrero de dos mil siete en la CLÍNICA SAN JOSÉ, cuyo titular es la Fundación Benéfica Casa Asilo San José, de [REDACTED] y que se encuentra [REDACTED] en Las Palmas de Gran Canaria [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que figura inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias desde fecha 10/04/2001.

Que la Inspección fue recibida por [REDACTED] Jefe Técnico de la Clínica, y por [REDACTED] operadora de la instalación radiactiva, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se componía de un equipo fijo y de uno portátil. _____
- El equipo fijo, de marca y modelo [REDACTED] se encontraba instalado en una sala plomada y reglamentariamente señalizada, situada en la planta Sótano del edificio. _____



CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/01/RX/GC-2242/2007

Hoja 2 de 3

- ██████████
- El equipo móvil era un arco radioquirúrgico, de marca y modelo ██████████ que se utiliza en la zona de quirófanos. _____
 - En la instalación se encontraba otro equipo de radiodiagnóstico, ██████████, inutilizado, en espera de ser retirado por la empresa ██████████ de la existe un certificado que así lo asevera. _____
 - No era visible ningún cartel de aviso a embarazadas. _____
 - Disponían de 4 equipos de protección plomados. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN


- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma de agua, con el equipo fijo, se midieron tasas de dosis similares a las del fondo radiológico normal, en la cabina de control. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- La persona que dispone de acreditación para Dirigir es la radióloga D^a ██████████ _____
- Se efectúa la vigilancia dosimétrica de 4 trabajadores expuestos (la radióloga, la Técnico y dos auxiliares de Quirófanos) mediante dosimetría personal, siendo los valores de los registros dosimétricos menores a 1'1 mSv/año en 2006. _____
- Según manifestaron, aunque hay varios médicos que utilizan el arco radioquirúrgico, éste siempre es operado por la Técnico. Dichos médicos no disponen de control dosimétrico. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se entregó al inspector el informe anual correspondiente al año 2006, realizado por la UTPR ██████████. Según dicho Informe, en fecha 04/12/2006 se realizó un control de calidad del equipo. En él no figuran anomalías. Según se manifestó, el nombre del técnico de la UTPR que realizó las pruebas era ██████████ aunque se desconocían sus apellidos. _____

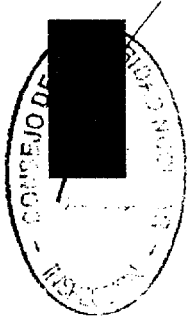


CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/01/RX/GC-2242/2007

Hoja 3 de 3

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintitrés de febrero de dos mil siete.

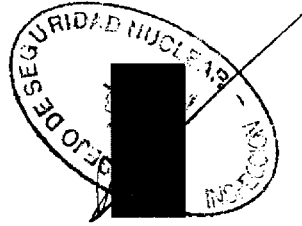

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "**CLÍNICA SAN JOSÉ**" (Las Palmas de Gran Canaria) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Conforme a lo acordado

CLINICA SAN JOSE
GERENCIA