

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día trece de marzo de dos mil trece en la "Clínica San Juan", cuyo titular es "Clínica San Juan de Écija SL", con NIF [REDACTED] y que se encuentra ubicada en la calle [REDACTED] de Écija (C.P.- 41400), en Sevilla.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde fecha 16/09/2003.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED] operadora de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación consta de un solo equipo de radiografía general de la marca y modelo [REDACTED] con generador [REDACTED] instalado en una sala plomada, reglamentariamente señalizada con trébol y con carteles de aviso a embarazadas y con acceso controlado. _____
- El equipo es operado desde una sala de control provista de visor plomado. _____

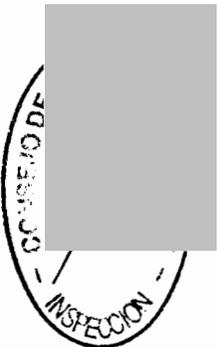

- El sistema de captación de imagen y visualización de la misma, era digital CR. _____
- En el momento de la inspección se disponía de un delantal y guantes plomados. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN

- Mientras se utilizaba el equipo sobre un fantoma líquido, se efectuaron medidas de tasa de dosis, obteniéndose los siguientes valores máximos:
 - 13 $\mu\text{Sv/h}$ en la ubicación del operador.
 - 2 $\mu\text{Sv/h}$ en el exterior de la puerta que da al pasillo. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Según manifestaron, Dirige la instalación D. _____, que dispone de Acreditación del CSN para dicha función, y opera el equipo D^a _____ que también dispone de Acreditación para operar. _____
- Se disponía de un dosímetro personal a nombre de la operadora, con lecturas actualizadas y valores acumulados de 0'00 mSv/5años. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN


- Se disponía de un contrato escrito con la UTPR _____ de 3/07/2010. _____
- Se disponía de un Programa de Protección Radiológica, en el que figura que los trabajadores expuestos de esta clínica son de categoría B. _____
- Se disponía de un Certificado de Conformidad de la instalación de fecha 31 de marzo de 2011, firmado por la UTPR _____ en el que no se reseña ninguna disconformidad. _____
- Disponían de informe de dosis a paciente. _____
- Disponían de informe de control de calidad y medida de niveles de radiación, de fecha 19/01/2012, en los que no se indican anomalías. _____
- Guardan las Hojas de Trabajo relativas al Mantenimiento del equipo. _____




DESVIACIONES

- No se han detectado. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 35/2008 por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a cuatro de abril de dos mil trece.

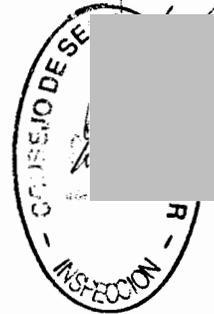

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 35/2008 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "CLINICA SAN JUAN" (Écija) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



Écija 15-4-2013