


ACTA DE INSPECCIÓN

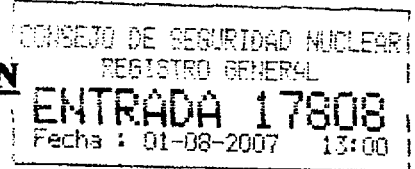

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA QUE: Se ha personado el día dos de julio de dos mil siete en el Gabinete Radiológico y Herbolario San Roque, de [REDACTED] sito en la calle [REDACTED] en El Arahal (C.P. 41600 - Sevilla).

La visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control del funcionamiento de la instalación radiactiva antes citada, dedicada a radiodiagnóstico médico, que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía con fecha 26/03/2002.



La Inspección fue recibida por D. [REDACTED], operador y propietario de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Protección Radiológica. Durante la inspección estuvo presente D. [REDACTED] radiólogo del centro.

El representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

- La instalación se compone de dos equipos instalados en la misma sala: un equipo de radiografía general, de marca y modelo Radiología [REDACTED] con nº de serie 7645, y un equipo dental panorámico [REDACTED]
- La sala disponía de señalización de trébol y era visible un cartel de aviso a embarazadas en la sala de espera.

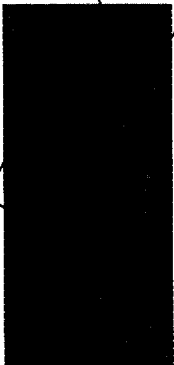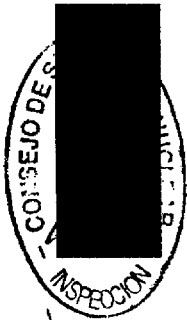

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/01/RX/SE-1980/2007


Página 2 de 3

- Las puertas eran plomadas y, según manifestaron, las paredes y visor también estaban plomados. _____
- Disponían de un delantal y de collarín plomados. _____
- Mientras se efectuaban disparos con el equipo dental, se midió una tasa similar al fondo radiológico en la posición de control. Mientras se disparaba con el equipo general, se midieron 4 $\mu\text{Sv/h}$ en la zona de control y 0'65 $\mu\text{Sv/h}$ en la camilla de la sala adyacente, cuando se dirigía el haz hacia el bucky situado en la pared colindante con esa camilla. _____
- Se mostró una copia del Informe Anual relativo al año 2006, presentado por la UTPR [REDACTED] en fecha 30/03/2007, en el que consta que se hizo un control de calidad en fecha 23/10/2006, por parte del técnico [REDACTED]. En el informe no se reseñan anomalías. _____
- El operador disponía de un dosímetro personal y de lecturas del mismo actualizadas y con valores de 0'00 mSv/5 años. _____
- Según manifestó el radiólogo, él no está allí de forma permanente y su tarea se limita a interpretar placas cuando le es solicitado. Tampoco ha ejercido hasta el presente ningún control de calidad acerca de la calidad de los estudios radiográficos que se realizan en el centro. _____

DESVIACIONES


- Aunque cuentan con un radiólogo, hasta la actualidad no hay un responsable del programa de garantía de calidad que ejerza de forma efectiva las funciones a las que se refieren los artículos 4 y 14 del Real Decreto 1976/1999 sobre criterios de calidad en radiodiagnóstico.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a trece de julio de dos mil siete.

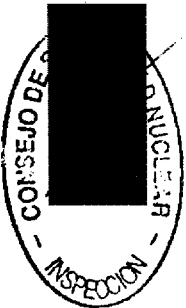



CSN/AIN/01/RX/SE-1980/2007
Página 3 de 3



TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento citado, se invita a un representante autorizado de la empresa "GABINETE RADIOLÓGICO Y HERBOLARIO SAN ROQUE " de EL ARAHAL (Sevilla), para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.