

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día doce de septiembre de dos mil siete en la CLÍNICA DENTAL DEL DR. [REDACTED] cuyo titular es "Multidental Aleman Español SLU", de [REDACTED] y que se encuentra en la calle [REDACTED] Puerto de Mazarrón (Murcia).


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que figura inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Murcia desde fecha 31/07/2003.

Que la Inspección fue recibida por D^a [REDACTED] Gerente del Centro y por D. [REDACTED], director y operador de la instalación radiactiva, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que acompañó al inspector D. [REDACTED], inspector acreditado de la Dirección General de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma Región de Murcia.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

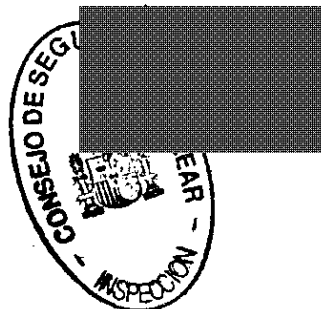



OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS


- La instalación se componía de un solo equipo dental intraoral, de la marca y modelo [REDACTED] y nº /S UAXA-130/541207. El equipo está instalado en una sala señalizada con trébol reglamentario. _____
- Era visible un cartel de aviso a embarazadas. Disponían de delantal plomado. _____
- La ubicación del operador está en el exterior de la sala, accionando un pulsador de pared _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma de agua, en la ubicación del operador se medía una tasa de dosis menor a 1 μ Sv/h. ____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- D. [REDACTED] disponía de Acreditación para Dirigir. _____
- Se efectúa la vigilancia dosimétrica del Sr. [REDACTED] única persona considerada como trabajador expuesto, mediante dosimetría personal, siendo los valores actualizados de los registros dosimétricos de 2'00 mSv en dosis acumulada anual,. _____

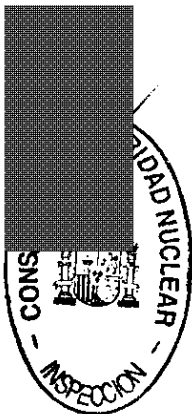


CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se mostró a la Inspección un certificado, de fecha 08-02-2006, de retirada de un equipo [REDACTED] firmado por [REDACTED] _____
- El último control de calidad fue realizado por la UTPR [REDACTED] En su informe no se observan anomalías. _____




DESVIACIONES

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintisiete de septiembre de dos mil siete.

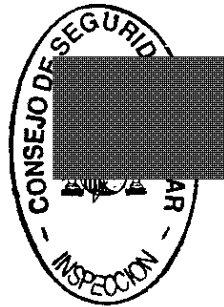

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "**MULTIDENTAL ALEMAN ESPAÑOL SLU**" (**Puerto Mazarrón**) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



x-16 421 735

Pto Mazarrón Murcia

17/10/07.