

ACTA DE INSPECCION

D/D^a [REDACTED], Inspector/a del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día veinte de enero de dos mil once, en el **SERVICIO DE INMUNOLOGÍA** del **HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL**, sito en la [REDACTED] en Madrid.


Que la visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control de una instalación radiactiva dedicada a la realización de técnicas de radioinmunoensayo para diagnóstico e investigación médica, con autorización de Puesta en Marcha concedida por la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía, con fecha 3 de septiembre de 1990, y con sede ubicada en el lugar citado.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor de la instalación y D. [REDACTED] pertenecientes al Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación se encuentra ubicada en la planta [REDACTED] del Hospital. _____
- La instalación dispone de un laboratorio con una zona de trabajo con isótopos radiactivos que se encuentra bien delimitada y de un laboratorio donde se depositan los residuos radiactivos temporalmente y se almacenan los productos radiactivos en el frigorífico. _____

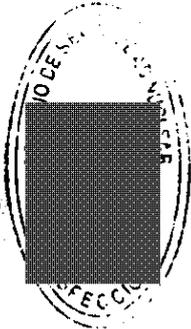

- Las dependencias de la instalación se encuentra señalizadas en el exterior como Zona Vigilada, dispone de medios para establecer un control de acceso, material de radioprotección, solución descontaminante y contenedores para la gestión y almacenamiento temporal de residuos radiactivos. _____
- En el momento de la inspección no se observaron isótopos o actividades no autorizadas. _____
- Según se manifiesta a la inspección y se comprueba en el Diario de Operación, actualmente solo trabajan con I-125. _____
- Disponen de Diario de Operación, ref. 402.01.87, en el que se anotan las entradas/salidas de material radiactivo, la dosimetría y el control de contaminación y niveles de radiación. No hay anotadas incidencias. ____
- Disponen de una licencia de Supervisor y una licencia de Operador en vigor. _____
- No disponen de monitor de radiación propio. _____
- El Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica efectúa mensualmente controles de contaminación y niveles de radiación de la instalación. Disponen de registros (último 22 de diciembre de 2010). ____
- Los residuos radiactivos generados se almacenan en la instalación hasta su retirada por el Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica al Almacén General de Residuos. _____
- Todo el personal expuesto está clasificado como categoría B. Disponen de 3 dosímetros personales asignados al personal de la instalación, procesados por el  con último registro noviembre de 2010, y con valores de dosis profunda acumulada de fondo. _____
- Disponen de documentación justificativa de que el personal de la instalación conoce el Plan de Emergencia y el Reglamento de Funcionamiento. _____
- Está pendiente incorporar la Instrucción IS-18, sobre los criterios para la notificación de sucesos e incidentes radiológicos en instalaciones radiactivas, al Plan de Emergencia o al Reglamento de Funcionamiento de la instalación radiactiva. _____
- Está pendiente la elaboración de un procedimiento de "Comunicación de deficiencias" según el artículo 8 bis del Real Decreto 1836/1999, de 3 de

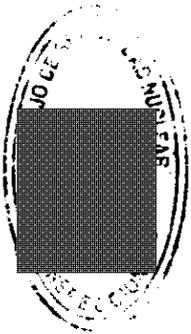

diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero. _____


- Las tasas de dosis medidas en la instalación no superaron el fondo radiológico ambiental. _____
- Se ha recibido en el Consejo de Seguridad Nuclear el informe anual de la instalación correspondiente al año 2009. _____

DESVIACIONES

- No se ha realizado formación en materia de protección radiológica para todos los trabajadores expuestos de la instalación. _____



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintiuno de enero de dos mil once.

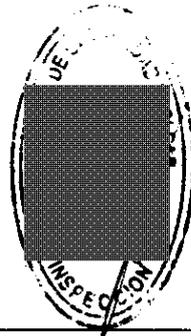

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del **"SERVICIO DE INMUNOLOGÍA del HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL"**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Se adjunta .



**Hospital Universitario
Ramón y Cajal**

Radiofísica y Protección Radiológica

 **Comunidad de Madrid**

Acta CSN/AIN/19/IRA 0921/11 (Inmunología)

TRAMITE

Durante el año 2010 se han realizado 15 actividades de formación continua (Cursos y Sesiones Clínicas) en la materia de protección radiológica con un total de 636 participantes trabajadores expuestos. Durante el año 2011 está planificada una actividad específica de formación en protección radiológica operacional para trabajadores expuestos de laboratorios que utilicen fuentes no encapsuladas.

Debido a la modificación del Programa de Protección Radiológica del Hospital Ramón y Cajal, realizada el pasado año de acuerdo con el RD 1085/2009, estamos elaborando los nuevos Planes de Emergencia y Reglamentos de Funcionamiento de las diferentes instalaciones radiactivas de acuerdo con la Instrucción IS-18 del CSN sobre criterios para notificación de sucesos e incidentes radiológicos.

Asimismo este año 2011 se elaborará el nuevo procedimiento sobre "Comunicación de deficiencias" de acuerdo con el artículo 8 bis del RD 1836/1999 modificado en el RD 35/2008.


Madrid, a 4 de febrero de 2011

VºBº
El Director Gerente

Edo.: Dr.



Hospital Universitario
Ramón y Cajal
Servicio de Radiofísica y
Protección Radiológica
Comunidad de Madrid

Fdo. Dr. 
Jefe Servicio Radiofísica y P.R.

DILIGENCIA



En relación con el Acta de referencia CSN/AIN/19/IRA/0921/11, de fecha veinte de enero de dos mil once, el Inspector/a que la suscribe declara con relación a los comentarios formulados en el trámite a la misma, lo siguiente:

Comentario 1: El comentario no afecta al contenido del acta.

Comentario 2: El comentario no afecta al contenido del acta.

Comentario 3: El comentario no afecta al contenido del acta.

Madrid, 9 de febrero de 2011

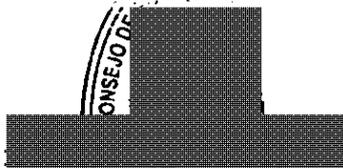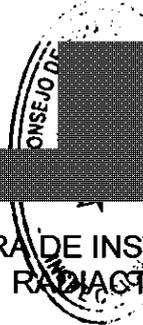Fdo. 

INSPECTORA DE INSTALACIONES
RADIATIVAS