

ACTA DE INSPECCIÓN

y _____, funcionarios de la Generalitat y acreditados por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspectores para el control del funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspección de control de los Servicios de Protección Radiológica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspección de transportes de sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICAN: Que se personaron el día siete de marzo de dos mil veintidós, en las instalaciones de la clínica dental cuyo titular es _____ de NIF: _____, ubicada en la _____ del municipio de Buñol, en la provincia de Valencia.

La visita tuvo por objeto la inspección de control, de una instalación de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, cuya declaración de inscripción vigente (DCL-1) en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, fue concedida por parte del Servicio Territorial de Energía con fecha 5 de abril de 2013 y número de registro 46/IRX/2262.

La inspección fue recibida por _____, auxiliar de la clínica, quien aceptó la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACIÓN

- La instalación consta de las siguientes salas y equipos:

Sala 1. Equipo intraoral.

- Equipo intraoral de la firma _____, modelo _____, n/s _____, que alimenta a un tubo de la misma firma _____, modelo _____, n/s _____ y condiciones máximas de funcionamiento de 70 kVp y 7 mA. _____



- El equipo dispone de pulsador de disparo con cable de extensión < 2 metros, realizando las exploraciones desde el exterior de la sala. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona vigilada indicativa de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso y paredes convencionales; y suelo y techo de material forjado. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, esterilización, sala equipo ortopantomografía, vivienda contigua y calle; vivienda en su parte superior y garaje en la inferior. _____

Sala Equipo Ortopantomógrafo.

- Equipo Panorámico con cefalometría de la firma _____, modelo _____, n/s _____, que alimenta dos generadores, uno modelo _____ (_____) y n/s _____ y otro modelo _____ (_____) y n/s _____, y cada uno con un tubo de firma _____, modelo _____, n/s _____ y _____ respectivamente, con condiciones máximas de funcionamiento de 85 kVp y 10 mA. _____
- El puesto de control del equipo se ubica en el exterior de la sala, disponiendo de pulsador junto a la puerta de acceso. _____
- La puerta de acceso está señalizada como zona controlada indicativa de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso y paredes emplomadas. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, sala 1, sala 2, pasillo y vivienda contigua; vivienda en su parte superior y garaje en la inferior. _____



DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- La instalación dispone de un delantal y un protector de tiroides, ambos emplomados, como medios de protección contra las radiaciones ionizantes. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- La instalación dispone de una acreditación para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico médico. _____
- El personal reflejado en el PPR está clasificado como categoría B. _____
- La instalación dispone de un dosímetro personal de termoluminiscencia (TLD), asignado a los trabajador expuesto (TE), procesado por la entidad _____, y cuya última lectura corresponde al mes de diciembre de 2021. _____


CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- La instalación está inscrita en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico del Servicio Territorial de Industria y Energía, con número de registro 46/IRX/2262. _____
- Disponen de copia de la documentación presentada ante el organismo competente para la inscripción de la instalación en el registro. Asimismo disponen de la documentación de la modificación por cambio de equipo intraoral declarada ante el organismo competente con fecha 3 de marzo de 2022. _____
- Disponen de certificado de retirada del antiguo equipo, marca _____, modelo _____ y n/s _____, realizado por la Empresa de Venta y Asistencia Técnica (EVAT), _____ con fecha 16 de abril de 2018. ____
- Disponen de las pruebas de aceptación y certificado de conformidad del nuevo equipo intraoral para su inscripción, firmados por la EVAT _____ con fecha 13 de abril de 2018. _____
- Los equipos instalados disponen de certificado de conformidad del marcado CE. ____
- La instalación dispone de contrato de prestación de servicios con la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) _____, firmado con 7 de febrero de 2018. _____
- La instalación tiene definido, implantado y actualizado un Programa de Protección Radiológica (PPR), firmado con fecha 4 de diciembre de 2019, incluyendo normas y procedimientos de trabajo. _____
- Disponen del último certificado periódico de conformidad de la instalación, firmado por la UTPR contratada con fecha 15 de diciembre de 2021. _____
- El último control de calidad de los equipos, verificación radiológica de la instalación y estudio de dosis paciente, han sido realizado por la UTPR contratada con fecha 15 de diciembre de 2021, sin anomalías. _____
- Disponen de registros informáticos y en papel de las exploraciones realizadas. ____
- El último informe periódico de la instalación ha sido enviado al Consejo de Seguridad Nuclear por la UTPR contratada en el año 2021. _____



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear: la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X con Fines de Diagnóstico Médico, se levanta y suscribe la presente acta, en L'Eliana, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Firmado por	Firmado por
, el día	, el
14/03/2022 con un	día 14/03/2022, con un
certificado emitido	certificado emitido por
por	

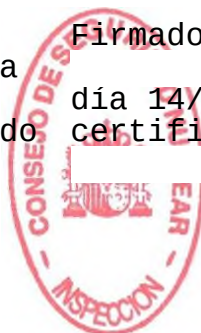

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, se invita a un representante autorizado de la instalación cuyo titular es _____ para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado digitalmente por

Fecha: 2022.03.16 10:49:06 +01'00'