


ACTA DE INSPECCION

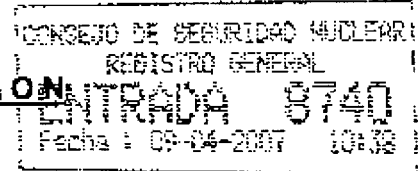

████████████████████ Inspectora del Consejo de Seguridad Nuclear.


CERTIFICA: Que se ha personado el día veintidós de marzo de dos mil siete en "CENTRO DE ANALISIS SANITARIOS" sito en ██████████ Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a Análisis clínicos por radioinmunoensayos y cuya última autorización de modificación (MO-4) fue concedida por Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid con fecha 11 de junio de 1997.

Que la Inspección fue recibida por ██████████ Supervisora de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:




- No ha habido cambios en la instalación con respecto a lo descrito en la última visita de inspección de fecha 26 de abril de 2006. _____
- Las dependencias - laboratorio de manipulación y almacén de residuos- se ajustan a lo establecido en la autorización de la instalación y se encontraban señalizadas conforme al reglamento. El acceso a la instalación se controla a través del personal de recepción (las puertas de las dependencias no disponen de llaves). _____

CSN/AIN/16/IRA/1546/07

Hoja 2 de 3



- El día de la inspección el material radiactivo, en uso, corresponde a las últimas entradas de I-125 (cantidad total inferior a 25 μ Ci). _____
- Todas las entradas de material radiactivo se encontraban anotadas en el Diario de Operaciones y los albaranes correspondientes archivados.
- Del análisis de estos datos se deduce que desde la última inspección únicamente ha habido entradas de kits de I-125 de 5 μ Ci cada uno (comercializados por _____). Entradas muy por debajo de las actividades máximas autorizadas. _____
- Estaba disponible el detector de contaminación de marca _____ Modelo _____ (n/s 31254), en estado operativo (última calibración en junio de 2004). _____
- Los residuos – sólidos y líquidos – se encontraban almacenados adecuadamente. Las bolsas de sólidos y los recipientes de líquidos estaban identificadas con las fechas correspondientes. _____
- La gestión interna de estos residuos se realiza siguiendo el protocolo establecido (entregado al CSN en 2005). Las retiradas por desclasificación de los residuos sólidos se encontraban anotadas en el Diario de Operaciones, (eliminándose una media de una bolsa por mes). No se encontraban anotadas las evacuaciones de los líquidos. _____
- Estaba disponible el Diario de Operaciones relleno y actualizado. _____
- Disponen de una Licencia de Supervisor, en vigor. La licencia de la supervisora se encuentra caducada desde noviembre de 2006. Estaba disponible la copia de la solicitud de tasas para la renovación de la licencia (de fecha 20 de marzo 2007). _____
- Se efectúa la vigilancia dosimétrica de los trabajadores expuestos disponiendo de dos dosímetros personales procesados por el _____
- El día de la inspección los últimos registros de lecturas dosimétricas que se encontraban disponibles corresponden al mes de Diciembre 2006 y acumulada, valores no significativos (dosis profunda máxima acumulada en 2006: 0.79 mSv). Del análisis de estos registros se deduce que en el curso del año 2006 estos dosímetros no se han leído todos los meses (faltan 3 meses). _____



CSN/AIN/16/IRA/1546/07



Hoja 3 de 3

- Según se manifiesta la supervisora ha realizado la revisión médica en [REDACTED] (servicio médico de la [REDACTED]) en diciembre de 2006. No estaba disponible el "apto médico". _____
- Estaba disponible la copia del informe anual correspondiente al las actividades del año 2006, enviado al C.S.N. el 21 de marzo de 2007. ____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintidós de marzo de dos mil siete.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "CENTRO DE ANALISIS SANITARIOS", en Madrid, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CENTRO DE ANALISIS SANITARIOS, S.L.
[REDACTED] te

Madrid, 4 Abril 2007.