



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce en el centro sanitario "Clínica Dental Imadent", que se encuentra ubicado en la calle [REDACTED] esquina a [REDACTED] de Brunete (C.P.-28690), en la provincia de Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico médico, ubicada dentro del centro sanitario referido, y cuyo titular es Imadent Clínicas Odontológicas SL, con CIF/[REDACTED]. La instalación se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid desde fecha 06/03/2007.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED] y D^a [REDACTED], Auxiliar del Centro y representante del titular, respectivamente, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica..


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación consta de tres equipos dentales distribuidos del modo siguiente:
 - Sala 1.- Equipo intraoral [REDACTED], con nº/s 31062048
 - Sala 2.- Equipo gemelo al anterior, con nº/s 31062047
 - Sala 3.- Equipo panorámico [REDACTED]. _____
- Las salas de los equipos estaban señalizadas reglamentariamente, y disponían de medios para un control de acceso efectivo. _____
- Según manifestaron, la sala del panorámico tiene sus paredes plomadas. La puerta y visor estaban plomados. _____

IMADENT Clínica Dental, S.L.
LOCAL 2
28690 B
ESPAÑA

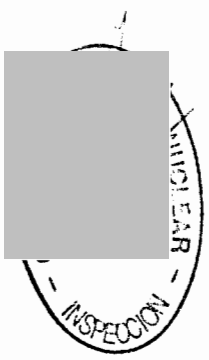



- Todos los equipos eran operados desde el exterior de las salas, mediante pulsadores de pared. _____
- Disponían de un delantal y un collarín plomados. _____
- El sistema de captación de imagen y visualización de la misma era de película convencional. _____
- Había carteles de aviso a embarazadas a la vista de las pacientes. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN

- Mientras se utilizaba el equipo panorámico se efectuaron medidas de tasa de dosis, obteniéndose valores similares al fondo radiológico natural tanto en la zona de control como en la sala de espera adyacente.


TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Según manifestaron, Dirige la instalación D^a _____ que dispone de Acreditación del CSN para tal función y ella es al mismo tiempo la única operadora de los equipos. No estaba presente en el momento de la inspección. _____
- Aunque en el Programa de Protección Radiológica disponible en la instalación se afirma que la dosimetría será de tipo Personal, el control dosimétrico de esta persona es realizado mediante un dosímetro TL de Área. Estaban disponibles las lecturas del mismo. Sus valores acumulados eran de 0'00 mSv/año. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Disponían de un Programa de Protección Radiológica firmado por la UTPR _____. En él la única Trabajadora Expuesta está clasificada como de categoría B. _____
- Disponían de normas de trabajo escritas para el operador. _____
- Se disponía de un informe de resultados de un control de calidad de los equipos, revisión de áreas y estimación de dosis a pacientes, efectuados por la misma UTPR en fecha 26/12/2013. Según dicho informe, el

MADRID
C/ME
28000

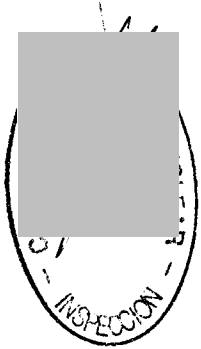

técnico que realizó la visita fue D [REDACTED] En él no se hace constar ninguna anomalía o parámetro fuera de tolerancias. _____

- Aunque en el momento de la inspección no se disponía de un contrato escrito con la UTPR éste fue puesto a disposición del inspector con posterioridad. _____

DESVIACIONES

- **UNO.-** No estaba disponible el **Certificado de Conformidad de la instalación**, firmado por la UTPR, a que se refiere el artículo 18.e) del Real Decreto 1085/2009 o Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico. _____
- **DOS.-** No disponían de un **protocolo escrito para la asignación de dosis** a los trabajadores expuestos a partir del dosímetro de área, incumplándose por tanto el Artículo 31 del RD 783/2001, Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 35/2008 por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticinco de septiembre de dos mil catorce.



IMADENT UNIDAD DENTAL
C/ME...
28800...
[REDACTED]

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 35/2008 citado, se invita a un representante autorizado del Centro **“CLINICA DENTAL IMADENT” (Brunete)** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL
ENTRADA 15619
Fecha: 06-10-2014 12:34

[Redacted]
28690 MADRID

[Redacted]
[Redacted]

02 de octubre de 2014

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ATT.: D. [Redacted]
Ref.: CSN/AIN/01/RX/M-553072014

En contestación al Acta de Inspección con nº.: CSN/AIN/01/RX/M-553072014, realizada en la Clínica Dental Imadent, S.L, con [Redacted], el día 16 de septiembre del 2014, por el Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear D. [Redacted] comunicamos que se ha procedido a cambiar el Dosímetro que actualmente teníamos de Área por el Dosímetro Personal; [Redacted], nos hará llegar un Certificado con el cambio en unos días.

Adjuntamos también en el sobre el Acta de Inspección firmado.

Un saludo,

[Redacted Signature Block] S.L.
(L. 2)
PANA

Fdo.: [Redacted]