

**ACTA DE INSPECCIÓN**

<b>Instalación</b>	[REDACTED]		
<b>Titular</b>	[REDACTED] Y OTRO SC		
<b>Dirección</b>	[REDACTED] 07800 EIVISSA		
<b>Código</b>	RXMPM 1103	<b>NIF</b>	[REDACTED]
<b>Actividad</b>	General	<b>Tipo</b>	II
<b>Fecha inscripción</b>	14/12/1992	<b>Última anotación</b>	14/05/2013
<b>Fecha inspección</b>	15/04/2016	<b>Finalidad</b>	Control

D. [REDACTED] jefe del Servicio de Seguridad Nuclear del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

**CERTIFICA:** Que se personó el quince de abril de 2016 en la instalación a nombre de de [REDACTED] Y OTRO SC, sita en [REDACTED] 07800 EIVISSA.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido cuyo código de registro es RXMPM 1103, a nombre de [REDACTED] Y OTRO SC, inscrita en el Registro el 14 de diciembre 1992, y cuya última notificación de inscripción fue realizada el 15 de mayo 2013.

La Inspección fue recibida por [REDACTED] y [REDACTED], titulares de la instalación, quienes fueron informados de la finalidad de la misma y manifestaron aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.



De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

#### UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación dispone del equipos que se relaciona a continuación, inscrito en el Registro de instalaciones de rayos X de diagnóstico médico:

Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
			150	400

#### DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

-  dirige la instalación y no dispone de la acreditación correspondiente.
- Se realiza el control radiológico de  mediante el uso de dosimetría personal. Está disponible el registro de las dosis recibidas por dicho personal, sin que se hayan sobrepasado los límites de dosis establecidos.

#### TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN


- Está disponible el certificado de conformidad de la instalación emitido por la UTPR  el 1 de marzo de 2016.
- Se ha realizado durante el mes de marzo de 2016 el control de calidad de equipos, la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo y en las áreas colindantes y la verificación de dosis a pacientes.
- El certificado de  de 1 de marzo de 2016 indica que el equipo   presenta parámetros que superan los valores de tolerancia.



#### CUATRO. DESVÍOS

- La persona que dirige la instalación no dispone de la acreditación correspondiente.
- No consta que se hayan tomado medidas para corregir las deficiencias que presenta el equipo [REDACTED]

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado, en Palma en la sede de la Dirección General de Política Industrial el 22 de abril de 2016.

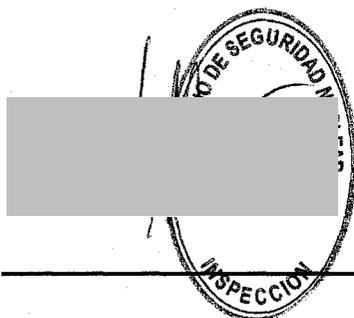

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de [REDACTED] Y OTRO SC para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.



IBIZA

Conselleria de Treball,  
Comerç i Indústria

17 MAIG 2016

Núm.

16.883

REGISTRE D'ENTRADA

D. [REDACTED]  
DIRECTOR GENERAL DE POLITICA INDUSTRIAL  
GOVERN DE LES ILLES BALEARS

D. [REDACTED], con D.N.I. [REDACTED] R, Licenciado en Medicina y Cirugía, Director Sanitario del Centro Médico Polivalente "Centro Médico del Chequeo", sito en la [REDACTED] de Ibiza, inscrito en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios con el N° 3545, desea comunicarle:

Que desde el primer momento que tuve conocimiento de la avería del Equipo [REDACTED] me puse en contacto con D. [REDACTED], con NIF. [REDACTED] ( Telf. [REDACTED] ), Técnico de [REDACTED] ( Empresa que nos instaló el equipo de Rx) comentándome varias posibilidades de actuación, y a pesar de que en principio restaba importancia a la avería, me sugirió que desconectase el equipo del sistema eléctrico dejándolo no operativo, lo cual hice inmediatamente (si lo desea tengo a su disposición todos los correos electrónicos)

Mi compañero, D. [REDACTED] primero y yo posteriormente, hablamos con D. [REDACTED] de la empresa [REDACTED] L. de Palma de Mallorca, el cual nos comentó que era una avería muy frecuente en los equipos [REDACTED] y que lo mejor era proceder a su retirada.

El miércoles 4 de Mayo 2016 acordamos aceptar el consejo dado por D. [REDACTED], el cual se desplazó a Ibiza el 10 de Mayo de 2016, procediendo a la desinstalación del Generador Rx y Tubo Rx del Equipo [REDACTED]. Estamos a la espera de que expida el certificado de retirada del equipo y una vez que lo tengamos en nuestro poder lo remitiremos a D. [REDACTED] para que pueda dar de baja la instalación en el Registro.

También desearía comentarle que me puse en contacto con el Sr. [REDACTED] L de [REDACTED] para que me inscriba en el próximo curso que dará D. [REDACTED] en Valencia para dirigir u operar aparatos de Rx.

D. [REDACTED] realizó en Ibiza los días 25, 26, 27 y 28 de Noviembre de 1993 un curso que acreditaba para dirigir u operar aparatos de Rx con fines diagnósticos. Al mismo asistieron D. [REDACTED] y D. [REDACTED] (socio cofundador en 1983 del



IBIZA

Centro Médico del Chequeo). D. [REDACTED] y yo no pudimos asistir al mismo ya que en nuestro Centro Médico se realizaban los reconocimientos médicos para la revisión u obtención de los permisos de conducir y armas de Ibiza y Formentera y no podíamos cerrar tantos días.

Se nos comentó que se realizarían más cursos en Ibiza aunque hasta la fecha de hoy no se ha realizado ninguno.

D. [REDACTED], Médico Odontólogo, ejerce su actividad en las mismas instalaciones que yo y su clínica forma parte del Centro Médico Polivalente que yo dirijo.

D. [REDACTED] realizó estudios de [REDACTED] y al cabo de varios años decidió abandonar el Centro Médico del Chequeo.

Las radiografías las podría haber realizado [REDACTED] pero lo hacía yo por considerar ambos que los conocimientos tanto técnicos como de diagnóstico eran igual o superiores a los suyos.

Le puedo asegurar que desde que ejerzo la medicina, la salud del paciente siempre ha sido mi prioridad y que al Equipo [REDACTED] se le han realizado de forma periódica controles de calidad y medida de niveles de radiación.


A mi, de forma mensual, se me han realizado controles de dosimetría sin que hasta la fecha de hoy haya habido incidencias. Ponemos a su disposición si lo desea un archivo donde figuran todos estos datos.

Soy una persona honesta y siempre he actuado de buena fe, por lo que le ruego que todos los apartados sean considerados información reservada o confidencial.

Es gracia que espero alcanzar y dándole las gracias anticipadas le deseo todo lo mejor.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Reciba un cordial saludo,



Fdo. D. [REDACTED]

Ibiza, 16 de Mayo de 2016



IBIZA

D. [REDACTED], con D.N.I. [REDACTED], Licenciado en Medicina y Cirugía, Colegiado en el Colegio de Médicos de Baleares con el N° [REDACTED] y acreditado para dirigir u operar aparatos de Rx con fines diagnósticos desde el 20 de Diciembre de 1993 y en representación de [REDACTED], con NIF. [REDACTED]

Hace constar:

Que estuve presente en la inspección que realizó [REDACTED], Jefe del Servicio de Seguridad Nuclear del Govern de les Illes Balears el día 15 de Abril de 2016 y que todo lo que se manifiesta en el acta de inspección se corresponde con la realidad. No obstante, desearía puntualizar que D. [REDACTED] y D. [REDACTED]; son licenciados en Medicina y Cirugía, y que ambos superaron satisfactoriamente en la universidad la asignatura de Radiología General y Física Médica (efecto de la radiación sobre el cuerpo humano y respuesta de éste a la misma, etc. etc.).

Sin más, firmo la presente en Ibiza a 16 de Mayo de 2016

Saludos,



Fdo. D [REDACTED]

**DILIGENCIA**

En relación con la tramitación del acta de inspección de referencia CSN/CAIB/AIN/C01/RXPM-1103/2016, de 15 de abril de 2016, el inspector que la suscribe declara que la documentación remitida por [REDACTED] y otro SL se acepta en lo que se refiere al desvío relativo a las deficiencias en el equipo de rayos X, y no modifica ningún otro aspecto del contenido del acta.

Palma, 18 de mayo de 2016

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
INSPECTOR

