

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día diez de marzo de 2009 en las instalaciones médicas del Centro de Asistencia, en Alcantarilla, de la mutua IBERMUTUAMUR, de CIF [REDACTED], sita en C/ [REDACTED] Alcantarilla (C.P. 30820), Murcia.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico general, y que tiene la última inscripción, con el nº RX/MU -1080 en el Registro Oficial de Instalaciones de rayos X para Diagnóstico Médico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 8/04/2003.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Delegado, D. [REDACTED], Director y D.ª [REDACTED], Enfermera que colaboró durante la inspección.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES



UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación, está ubicada en el bajo de un edificio de vecinos y consta de un equipo [REDACTED] modelo F [REDACTED] nº de serie 01929. _____
- La sala de la instalación se encontraba señalizadas reglamentariamente, con letrero de aviso a embarazadas. _____
- Se disponen de medios suficientes para establecer un acceso controlado. ____







- Según manifiestan a la Inspección la sala dispone de puertas, y mamparas plomados. La sala de RX colinda con el despacho de enfermería. _____
- La instalación dispone de señalización luminosa con encendido manual para indicar el momento de funcionamiento del equipo de RX. _____
- En la instalación hay un delantal plomado. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN


- Durante la inspección se realizaron varios disparos con el equipo  modelo P  seleccionando la técnica: 80 kV y 4 mAs, leyéndose tanto en el puesto del operador como en el pasillo y el despacho de enfermería, tasa de dosis inferior a 0,3 μ Sv/h. _____




TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Se comprueba la acreditación del Director, D.  D.^a  sustituye a D.^a  Operadora acreditada, por estar en baja por embarazo. _____
- En el momento de la inspección comprueba informe de control periódico dosimétrico de un dosímetro personal que porta habitualmente la Operadora titular, realizado por  que no arroja valores significativos. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se comprueba el Control de Calidad anual realizado por la UTPR  en mayo de 2008 sin anomalías que destacar. _____
- Se verifica el envío al CSN del informe anual, correspondiente al año 2008, en febrero de 2009, sin incidencias destacables. _____

DESVIACIONES.

- En el momento de la inspección D.^a  no dispone de la acreditación para operar equipos de radiodiagnóstico, incumpliendo la especificación técnica nº 3 del Anexo 1.2 del real Decreto 1891/1991. _____

- En el momento de la inspección D^o [REDACTED] no disponía de dosímetro personal, incumpliendo la especificación técnica nº 6 del Anexo 1.2 del Real Decreto 1891/1991. _____
- No está disponible la inscripción del equipo [REDACTED] modelo [REDACTED] nº de serie 01929. _____
- El cumplimentado del Diario de Operaciones disponible no se ajusta a los requisitos que se indican en la especificación técnica nº 2 del Anexo 1.2 del Real Decreto 1891/1991. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a dieciséis de marzo de dos mil nueve.



INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C. S. N.

Fdo.: [REDACTED]

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de la MUTUA IBERMUTUAMUR, en Alcantarilla, Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

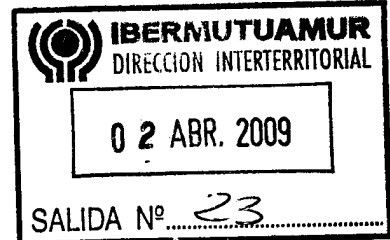
*Se adjunta escrito con las alegaciones
al contenido del acta.*

Murcia, 2 de Abril de 2009

Fdo. [REDACTED]

Región de Murcia**Consejería de Universidades, Empresa e Investigación****Dirección General de Industria, Energía y Minas**

████████████████████
30005 Murcia

S/REF: CSN/AIN/1/RX-MU-1080/2009**Exp.:** Acta de Inspección 10/3/2009**A/A:** ████████████████████

Siguiendo sus instrucciones, adjuntamos un ejemplar del Acta firmado y
fechado alegando las siguientes manifestaciones al contenido de la misma:

1. A partir de la fecha ██████████ va a dejar de trabajar con el equipo de rayos X, únicamente efectuará radiografías el Director de la Instalación, ██████████ hasta la reincorporación de ██████████. En cuanto a la dosimetría, ██████████ al dejar de ser trabajador profesionalmente expuesto no es necesario que disponga de dosímetro individual. Por otro lado, indicar que ██████████ si dispone de dosímetro individual.
2. A partir de la fecha se va a proceder a cumplimentar el Diario de Operaciones de acuerdo con lo indicado en la especificación técnica nº 2 del Anexo 1.2. del RD 1891/1991.
3. No se encontró disponible la Inscripción del equipo ██████████ debido a que se solicitó una modificación de fecha 09/01/2008 por cambio de equipo de rayos X en nuestras instalaciones de Alcantarilla (MU-1080) sin embargo quedo parada por carecer el equipo de marcado CE, por lo que con el fin de que siga su trámite, adjuntamos copia de la baja del equipo ██████████ en la anterior ubicación en la que estuvo inscrito (MA-1454).

IBERMUTUAMUR - M.A.T.E.P.S.S. Nº 274**C) ██████████****30820 ALCANTARILLA -MURCIA-**