


163447

CSN/AIN/01/IRA/2862/07



**ACTA DE INSPECCION**

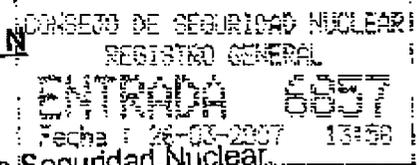

[Redacted], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día doce de marzo de dos mil siete en **CENTRO DE ENSAYOS Y MEDIO AMBIENTE S.L.**, sita en [Redacted] (Murcia).


Que la visita tuvo por efectuar la inspección previa a la notificación de puesta en marcha de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a la utilización de equipos para la medida de densidad y humedad de suelos, cuya autorización fue concedida por Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia con fecha 27 de noviembre de 2006.

Que la Inspección fue recibida por [Redacted] futuro Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Dentro de la nave industrial se encuentra un [Redacted] en [Redacted] señalado, para el almacenamiento de los equipos.
- Disponen de un equipo [Redacted] MC-3, nº M-361208550.
- Se midió una tasa de dosis de 2 µSv/h en contacto con la puerta metálica.

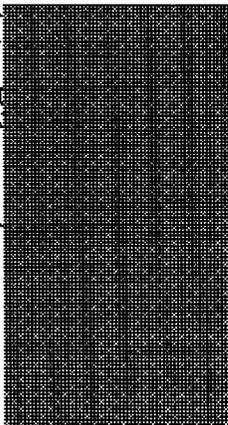

- Estaban disponibles los certificados del equipo y fuentes radiactivas que aloja. \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ efectuó pruebas de hermeticidad y calibración del equipo en fecha 29-1-07. \_\_\_\_\_
- Han suscrito con \_\_\_\_\_ un contrato de mantenimiento del equipo. \_\_\_\_\_
- Dispone de dos equipos de medida \_\_\_\_\_ Monitor 4, calibrados en fecha 27-10-06. \_\_\_\_\_
- Disponen de material de balizamiento. \_\_\_\_\_
- Disponen de un Diario de Operación general y otro para el equipo. \_\_\_\_\_
- Disponen de dos dosímetros personales TLD. \_\_\_\_\_
- Han solicitado una Licencia de Supervisor y la renovación de una de Operador. \_\_\_\_\_
- Efectúan reconocimientos médicos en la \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a trece de marzo de dos mil siete.



CONTRON DE CALIDAD DE CSN

**TRAMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **CENTRO DE ENSAYOS Y MEDIO AMBIENTE S.L.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.