

ACTA DE INSPECCIÓN

D^a [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó, acompañado por el Inspector acreditado por el CSN en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia D. [REDACTED] el día dieciocho de febrero de dos mil diez en la empresa **SERVICONTROL**, sita en la C/ [REDACTED] en Cartagena, Murcia.


Que la visita tuvo por objeto efectuar la preceptiva Inspección previa a la notificación de funcionamiento tras traslado de sede, de una instalación radiactiva destinada a gamma-grafía, ubicada en el emplazamiento referido y cuya autorización de puesta en marcha fue concedida por la Dirección General de Industria Energía y Minas de la Comunidad de Madrid con fecha veintisiete de enero de dos mil diez.

Que la Inspección fue recibida por [REDACTED] supervisor de la Instalación, en representación del titular, quién aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación central de **SERVICONTROL** se halla en Madrid en la calle [REDACTED] y la delegación autorizada en Cartagena Murcia consta de un recinto de almacenamiento y tiene

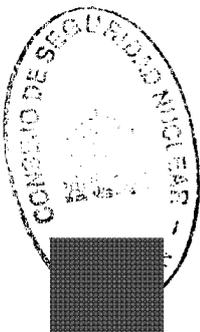

su domicilio social en el C [REDACTED]
[REDACTED] en Cartagena Murcia -----

- El recinto o búnker de donde se almacenan los equipos se encuentra en al fondo de una nave industrial. Según sentido de entrada, en el recinto anterior al del bunker se encuentra un almacén y posterior hay un patio. En ninguno de los colindamientos hay presencia permanente de personal durante la jornada laboral
- Hasta lo que es dado comprobar por la Inspección lo construido se adecua a lo presentado en la memoria de solicitud de autorización en cuanto a situación, dimensiones y tipo-----
- La inspección midió tasas de dosis en áreas colindantes y en puerta con los equipos dentro del bunker. resultado ; 0,3 microSv/h. -----





[REDACTED]

En el búnker de la delegación se almacenan los equipos que se encuentran asignados a la misma::

Equipo	Nº serie	revisión	A. Max
[REDACTED]	461	15/06/2009	3,33
[REDACTED]	3378	03/02/2010	55,50
[REDACTED]	4122	07/01/2010	62,30
[REDACTED]	5264	07/07/2009	48,65

- Para operar los equipos radiactivos se dispone, en la delegación de Cartagena, del siguiente personal

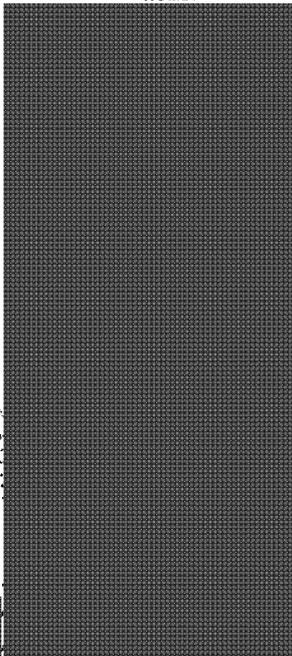
NOMBRE Y APELLIDOS	AYUDANTE/OPERADOR
	OP. R X INDUST
	AUXILIAR
	AUXILIAR
	OP. R X INDUST
	AUXILIAR
AUXILIAR	
AUXILIAR	
AUXILIAR	
AUXILIAR	
RENOVACION	

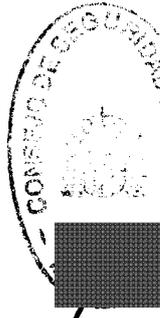

- Los trabajadores expuestos están clasificados en categoría A. El supervisor manifiesta que el personal de la delegación de Cartagena cumple lo establecido en Reglamento de Funcionamiento y Plan de Emergencia y que disponen cada uno de acceso a los citados documentos de lo que firman un recibí-----
- El supervisor Sr. D.  viene impartiendo, un programa de formación, "curso básico de protección radiológica" a los trabajadores recién incorporados Estaban disponibles los certificados de formación correspondientes.-----
- Estaban disponibles las últimas lecturas dosimétricas correspondientes al mes de diciembre de 2009 para 20 usuarios con dosis no significativa -----

- Disponen de los siguientes Dosímetros de lectura directa y monitores de radiación en la delegación de Cartagena: DLD – [REDACTED] con nº de serie 265768, 272689, 265730, 272688, 274110, 274109, 261395, 272162, 272176, 261400, 272695, 274128, 265769, 265767, 274119, y [REDACTED] nº 2080045 , También disponen de *RADIOMETRO-CALIBRACIÓN* [REDACTED] con nº de serie 36862, 36537, 36948, 37002, 36948, 37000, 36159-----
- Constan formularios para controlar las dosis diarias operacionales DLD cumplimentados por el propio trabajador. Estos controles deben ser revisados y firmados por el jefe de delegación-----

La vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos se hace en el correspondiente Servicio de Prevención. Estaban disponibles los certificados de aptitud -----

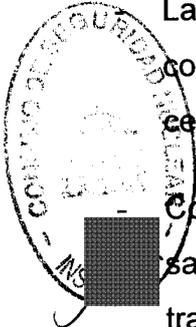 Consta que a fecha de Inspección, el supervisor planifica cada salida para los diferentes tipos de trabajo y emite un parte de trabajo, donde se indican los medios de protección radiológica a emplear El movimiento de los equipos, se controla mediante una ficha mensual de entrada y salida del recinto de almacenamiento y la rellenan los operadores. -----

- El supervisor manifiesta que se realizan al menos una vez al año inspecciones en obra a los operadores de la delegación de ~~*Cantabria~~ según procedimiento.-----
- Se encontraban disponibles, numerados y visados por el CSN, los diarios de operación general y de cada equipo sobre los que sella la Inspección-----



- Exhiben garantía financiera con [REDACTED] para afrontar costes de fuentes radiactivas en desuso-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a ocho de marzo de dos mil diez.

Fdo: [REDACTED]

Inspector

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **SERVICONTROL** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

EXISTE UNA ERRATA EN LA PÁGINA 4

[REDACTED]
SUPERVISOR IRA 1709
26-MARZO-2010 - MADRID.