



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, acompañado por D. [REDACTED] funcionario de la CARM e Inspector en prácticas del CSN, el día veintinueve de septiembre de 2011 en la instalación de rayos X para diagnóstico dental cuyo titular es D. [REDACTED] de NIF: [REDACTED] sita en [REDACTED] 32003-Cartagena.

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el domicilio citado, destinada a radiodiagnóstico General, cuya última inscripción registral es de 14 de diciembre de 2004, y su nº de inscripción es IR/MU-1303.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Odontólogo, Director y Titular de la instalación.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se encuentra ubicada en la letra A de la primera planta de un edificio de viviendas, donde se desarrolla la actividad de clínica dental. La instalación dispone de tres equipos de rayos X. _____

- Dos de ellos, un intraoral [REDACTED] modelo [REDACTED] con nº de serie 31000179/919246 y un [REDACTED] con nº de serie 870250/516/874266 están situados en sala específica con paredes plomadas, puerta plomada con visor de cristal plomado que permiten disparar, mediante pulsador, los equipos desde el pasillo de acceso exterior de la misma. El tercer equipo es un intraoral [REDACTED] con nº de serie C 545015/750479 dotado con cable extensible para disparo a más de 2 metros y está instalado en sala de exploración y consulta, con paredes plomadas. _____



- La instalación dispone de la señalización reglamentaria. _____
- Se disponen de un delantal, y mandil plomados. _____
- La instalación permite el acceso controlado de personas estando separada por paredes y distancia del personal laboral no expuesto y de la sala de espera de la clínica. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

- Se realizan disparos con los tras equipos registrando con el monitor de radiación situado en el puesto del operador que no han superado los 0,70 $\mu\text{Sv/h}$ en ningún caso. _____
- El titular manifiesta que realiza unas diez exposiciones al mes. _____

TRES GENERAL, DOCUMENTACIÓN

Se exhibe el Programa de Protección Radiológica. _____

Se exhibe el último control de calidad realizado por la UTPR _____ el 13/6/2011

Esta disponible el control de Calidad Anual. _____

- Hay contrato con la UTPR citada con la misma fecha.

Se verifica la acreditación del titular para dirigir la instalación.

La inspección comprueba el contrato de control de dosimetría personal desde 1/7/2011, con al empresa _____

DESVIACIONES

- En el momento de la inspección se detectan las siguientes carencias:
 - No se dispone de historial dosimétrico de la única persona expuesta. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre

Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a cuatro de octubre de 2011.





EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL C. S. N.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de D. [REDACTED] de Cartagena, Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a continuación, su conformidad o reparos al contenido del Acta.




Clínica Pagán

Especialidades Dentales



Adjunto envío ultima lectura
odontométrica.

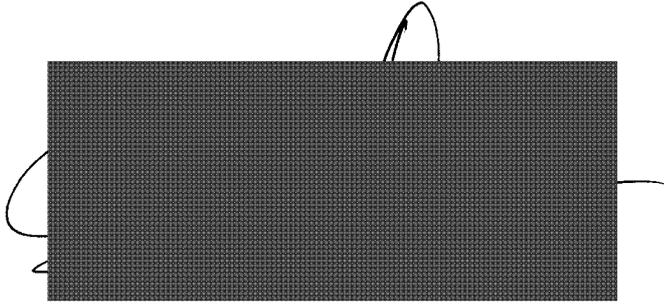

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN-RM/AIN/1/RX-MU/1303-2011** de fecha 29/09/2011, correspondiente a la inspección realizada en clínica dental de D. [REDACTED], sito en la calle [REDACTED] de Cartagena, Murcia

D. [REDACTED] representante de la instalación adjunta un ANEXO al contenido de la misma.

El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Se acepta el anexo del justificante de la única lectura de control dosimétrico correspondiente al mes de Agosto de 2011, sin que medien comentarios.

-La documentación aportada no modifica el contenido del acta

Murcia, 16 de noviembre de 2011

Fdo.: [REDACTED]