

## ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día treinta de septiembre de dos mil nueve en la clínica dental sita en la calle [REDACTED] de Gijón (Asturias), cuyo titular es [REDACTED] S.L., N.I.F. [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por su titular, que aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que la última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en septiembre de 2004 (IR-514).

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La instalación está señalizada, provista de acceso controlado y coincide sensiblemente con la que aparece en los datos del registro.-----

Se encuentran instalados un equipo [REDACTED] número de serie 101553/6510; un Trophy Irix 70 número 403388/SDXA119 y un ortopantomógrafo [REDACTED] número 13596.-----

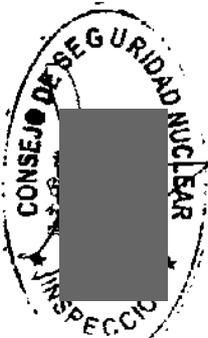



Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad del equipo de rayos X por la empresa [REDACTED] siendo las dos últimas de 17 de septiembre de 2009 y mayo de 2008.-----

Dispone de diario de operación, en el que se anotan los disparos diarios; de una acreditación para dirección de instalaciones de rayos X; de un delantal plomado y de programa de garantía de calidad.-----

Se realiza control dosimétrico de un usuario por [REDACTED] siendo la última lectura de agosto sin valores significativos.-----

No consta presentación de informe anual correspondiente a 2008.---

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y los Reales Decretos 1891/1991 y 1085/2009 sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a nueve de octubre de dos mil nueve.



**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de [REDACTED], para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

D [REDACTED] Presenta en referencia a que no consta presentación de informe anual de 2008, la siguiente documentación:

- Certificado de la UTPR, de la documentación del informe anual 2008 presentado
- Ficha de la clínica dental
- Acta de revisión del informe 2008

6304 a 23 Octubre de 2009