


CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

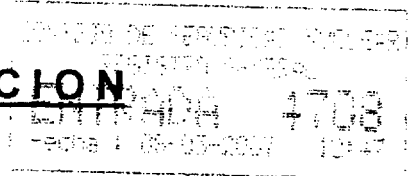

[REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear, acompañado por [REDACTED] Inspector y Técnico en prácticas respectivamente del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día ocho de febrero de dos mil siete en CLÍNICA DENTAL REYES CATÓLICOS, cuyo titular es CLINICA REYES CATÓLICOS, S.L. de [REDACTED], y que se encuentra en [REDACTED] Alcalá de Henares, en Madrid [REDACTED].

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid desde fecha 24-09-1999.

Que la Inspección fue recibida el Director de la Instalación [REDACTED] quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica. Acompañó al inspector [REDACTED], auxiliar.


Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se componía de dos salas situadas en la misma planta, ambas señalizadas reglamentariamente. _____

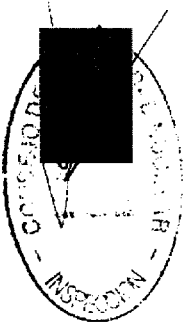

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/01/RX/M-3079/07

Hoja 2 de 3

- La primera sala albergaba el equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] correspondiente al nº serie G-7247. Según se manifestó, estaba fuera de servicio en el momento de la inspección. _____
- La segunda sala albergaba el equipo de ortopantomografía marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 90 Kvp y 15 mA máximos. El equipo se accionaba mediante un pulsador situado en el exterior de la sala. _____
- La sala que contiene el segundo equipo colinda con el pasillo y la sala de espera. Según manifestaron, tenía paredes plomadas. _____
- Era visible un cartel de aviso a embarazadas. _____
- Disponían de un delantal plomado. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN


- Mientras se efectuaban disparos, se midieron tanto en la puerta de la segunda sala como en la pared de la sala de espera un valor equivalente a Fondo. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Tanto el Director de la instalación como [REDACTED] disponen de acreditación del CSN para dirigir. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se ha realizado por parte de la UTPR [REDACTED] el Control de Calidad en fecha 21/06/2006, en el que no figuran anomalías. _____
- Disponían de Diario de Operaciones actualizado. _____
- Mostraron una copia del Programa de Garantía de Calidad. _____

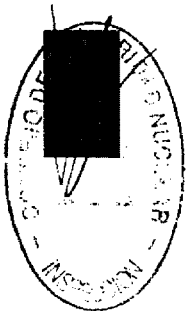

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR


CSN/AIN/01/RX/M-3079/07

Hoja 3 de 3

DESVIACIONES

- Se disponía de un solo dosímetro, compartido por los dos doctores. Se incumple por tanto la Especificación 6ª del Anexo I del Real Decreto 1891/1991, sobre instalación y utilización de instalaciones de radiodiagnóstico médico.



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintidós de febrero de dos mil siete.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "CLÍNA REYES CATÓLICOS" (Alcalá de Henares) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

ALCALA DE HENARES

5 - MARZO - 2007

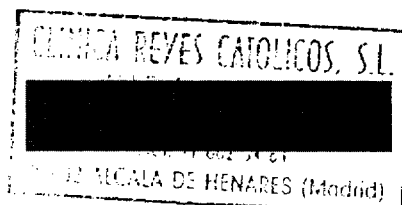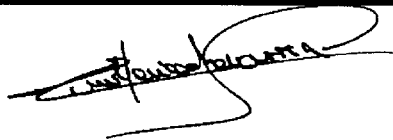

MÉDICOS ODONTÓLOGOS

28802 ALCALÁ DE HENARES

(Madrid)

Fuero fotocopia del contrato de los
dos dosímetros. No tenemos aún ninguna lectura-informe
del 2º dosímetro. Por favor si hay alguna
duda ponerse en contacto con la clínica.

En otro particular

Neutronics

