

CSN



CONSEJO
SEGURIDAD

ENTRADA 1446

Fecha: 28-01-2009 13:28

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día dieciocho de diciembre de dos mil ocho en el CENTRO MÉDICO ARCO IRIS, cuyo titular es CONSTRUCCIONES MAYRIT SA, de CIF [REDACTED] y que se encuentra en la calle [REDACTED] en Madrid (C.P.-28005).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita por última vez en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid en fecha 06/10/2008.

Que la inspección estuvo motivada por un escrito de la Comunidad de Madrid con fecha de Entrada 21/08/2008 en este Consejo de Seguridad Nuclear.

Que la Inspección fue recibida por D^a [REDACTED] recepcionista del Centro, quién aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación consta solo de 2 equipos dentales, instalados en sendas salas señalizadas con el trébol reglamentario. La sala del equipo ortopantomógrafo se encontraba plomada en paredes y puerta. _____

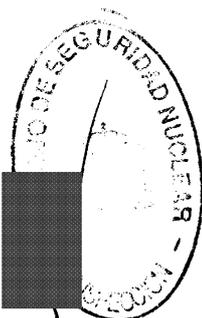

- Los equipos eran de la marcas y modelos siguientes:
 - 
 -  sin telerradiografía. _____
- Eran visible un cartel de aviso a embarazadas. _____
- Disponían de 1 delantal plomado. _____
- Ambos equipos utilizan tecnología digital. _____
- La ubicación del operador está, en el caso del intraoral, en el exterior de la sala, accionando un pulsador de pared. Y en el caso del panorámico, tras una mampara plomada. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN


- Mientras se efectuaban disparos con el equipo intraoral, se midieron tasas de dosis de 1'5 y 22 $\mu\text{Sv/h}$ en la ubicación del operador. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- La instalación es dirigida por D^a , que dispone de acreditación para Dirigir. _____
- La titular y la recepcionista disponen de dosímetros personales aunque no estaban disponibles las lecturas de los mismos. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN


- El Diario de Operación no tenía incidencias anotadas. _____
- Se disponía de un Certificado de Verificación de la UTPR  de fecha 17/12/2007, con fines de Declaración. _____
- Disponían de normas escritas de protección radiológica. _____
- Disponían de datos de un control de calidad realizado por D.   técnico de  en fecha 22/11/2007, así como de datos de dosis a pacientes de octubre de 2009. _____

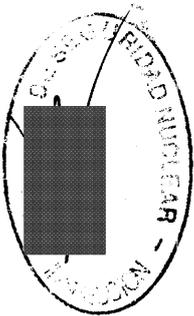

DESVIACIONES

- Aunque se comprobó la existencia de dosímetros, no estaban disponibles las lecturas correspondientes a los mismos. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diecinueve de diciembre de dos mil ocho.

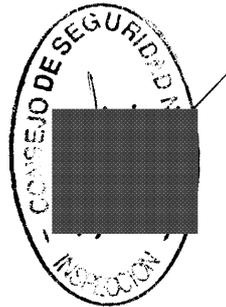

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del Centro **“CENTRO MÉDICO ARCO IRIS” (Madrid)** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Da. [Redacted]

Nº [Redacted]

[Redacted]

Adjuntamos informes dosimetricos de los meses ago, dic 08.