

ACTA DE INSPECCION

D/D^a [REDACTED] Inspector/a del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día diecisiete de febrero de dos mil once en **RECEMSA S.L.**, sita en el P. [REDACTED] en Humanes de Madrid, (Madrid).


Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección previa a la puesta en marcha de una instalación radiactiva destinada a la espectrometría por fluorescencia de rayos X con fines de análisis de aleaciones metálicas, cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid en fecha 19 de octubre de 2010, y con sede ubicada en el lugar citado.




Que la Inspección fue recibida por D^a [REDACTED] Supervisora de la instalación radiactiva, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación dispone de un equipo portátil de espectrometría por fluorescencia de rayos X de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] y n/s 53086.
- El equipo se almacena en su estuche de transporte que dispone de candado dentro de un armario metálico dotado de cerradura. _____
- Las llaves se encuentran custodiadas por el Supervisor de la instalación.

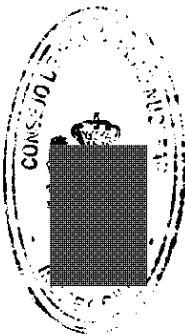


- Se mostró a la Inspección el certificado de conformidad del equipo. ____
 - Disponen de una licencia de Supervisor en trámite de concesión. _____
 - Disponen de 1 dosímetro personal gestionado por la UTPR 
 - Disponen de un monitor de radiación de la firma  modelo  n/s 37714 calibrado en origen en febrero de 2011.
 - Disponen de un programa de calibración de los sistemas de detección y medida de la radiación, en el que se indica que la calibración se realizará cada cuatro años y la verificación semestral. _____
 - Se comprobó que el equipo está protegido por una clave de acceso para su puesta en marcha, que dispone de indicador luminoso y sensor de proximidad. _____
 - El sensor de proximidad se encuentra desactivado porque en algunos casos se deben tomar medidas de virutas metálicas. _____
 - La activación de la radiación se realiza pulsando el gatillo y el pulsador de seguridad manual. _____
- Disponen de Diario de Operación diligenciado. _____
- No disponen de señalización reglamentaria. _____

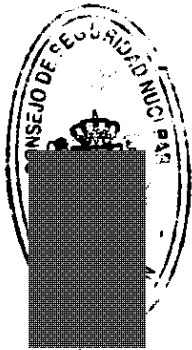

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la

presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diecisiete de febrero de dos mil once.



TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "RECEMSA S.L.," para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

En Madrid, 22 Febrero de 2011

D. [Redacted]

*Dejo constancia de disponer a fecha de hoy de la
sensibilización reglamentaria.*

Dada conformidad al contenido del Acta

Afectamente,

A large black redaction box covers the signature area. To the left, a portion of a rectangular stamp is visible, containing some illegible text.

Supervisora de la Instalación.

DILIGENCIA

En relación con el Acta de referencia CSN/AIN/01/IRA/3070/11, de fecha diecisiete de febrero de dos mil once, el Inspector/a que la suscribe declara con relación a los comentarios formulados en el trámite a la misma, lo siguiente:

El comentario no afecta al contenido del acta.

Madrid, 24 de febrero de 2011

Fdo.: 

**INSPECTORA DE INSTALACIONES
RADIATIVAS**