

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Funcionario de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias e Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear en la Comunidad Autónoma de Canarias,

CERTIFICA: Que se personó el día 15 de diciembre de dos mil nueve en la "CONSULTA DENTAL D. [REDACTED], cuyo titular es D. [REDACTED] con NIF [REDACTED], que se encuentra situada en la c/ [REDACTED] -1º, 35003 del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico dental, cuya última inscripción registral en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias es de fecha 04/10/1996.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] director de la instalación quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación estaba formada por un equipo instalado en una sala cuyos colindamientos coinciden con lo detallado en la documentación de la Declaración. _____




- El equipo, instalado en el despacho del director de la instalación, no disponía de marcado CE y era intraoral marca [REDACTED] modelo [REDACTED] con número de serie de generador [REDACTED] y número de serie de tubo [REDACTED]. _____
- Las puertas de las salas tenían su acceso controlado y la instalación se encontraba reglamentariamente señalizada. _____
- No era visible un cartel de aviso a embarazadas. _____
- Disponían un número suficiente de prendas de protección. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma de agua situado sobre el sillón dental, se midió un máximo de 15 $\mu\text{Sv/h}$ en la mesa del despacho y un máximo de 3 $\mu\text{Sv/h}$ en el exterior junto a la puerta de entrada haciendo uso del pulsador con cable extensible. _____
- Para realizar los disparos fueron utilizadas las prendas de protección. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- El director de la instalación es D. [REDACTED] que dispone de acreditación del CSN para dirigir instalaciones de rayos X con fines diagnósticos. _____
- Según manifiesta, en la instalación no hay operadores, procediendo siempre el director a realizar los disparos. _____
- D. [REDACTED] efectúa la vigilancia dosimétrica mediante dosimetría personal. La última lectura dosimétrica disponible correspondía a octubre de 2009, no observándose datos significativos a excepción de una dosis administrativa correspondiente a agosto de 2009 pero corregida posteriormente. _____
- Las lecturas dosimétricas se han realizado por [REDACTED] S.L. _____

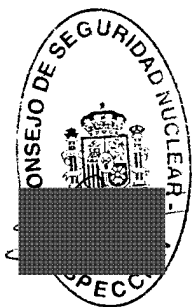

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN


- Según manifiesta el equipo actualmente casi no se usa, derivando a sus pacientes a otros centros que dispongan de equipos panorámicos. _____
- El último informe anual realizado a la instalación corresponde al año 2001 y fue realizado por la UTPR [REDACTED] _____
- Según manifiesta ha contratado los servicios de la UTPR [REDACTED] con el objeto de realizar, entre otras, la vigilancia radiológica y control de calidad del equipo. _____

DESVIACIONES


- El titular no ha realizado los controles de calidad del equipo y la vigilancia de los niveles de radiación correspondientes desde el año 2001. (Disposición adicional segunda y art. 18 del RD 1085/2009 de 3 de julio y art. 7 y 14 del RD 1976/1999, de 23 de diciembre).
- El último informe anual de la instalación corresponde al año 2001. _____
- No se pudo comprobar la existencia de Programa de Garantía de Calidad de la instalación (art. 2 del RD 1976/1999, de 23 de diciembre).
- No se pudo comprobar que se hubieran evaluado las dosis impartidas a los pacientes de acuerdo al Programa de Garantía de Calidad de la Instalación (art. 7.1 del RD 1976/1999, de 23 de diciembre). _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Las Palmas de Gran Canaria a 17 de diciembre de dos mil nueve.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de la "**CONSULTA DENTAL D.** [REDACTED] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

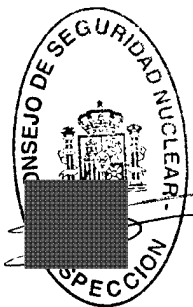

PROG SWO.

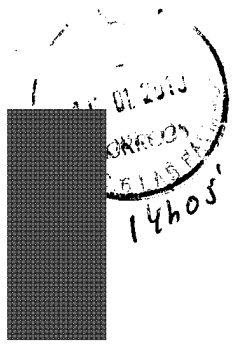

Gobierno de Canarias
Consejería de Empleo
Industria y Comercio
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA
Edificio de Usos Múltiples III -2ª Planta
C/ León y Castillo, 200
35004 -Las Palmas de Gran Canaria

REGISTRO GENERAL
Fecha: **21 ENE. 2010**

ASUNTO : CSN-CAC/AIN/01RX/GC- 2061/09

ENTRADA
Número: **7398**
CEIC: **15528** Hora:

[Redacted] con DNI [Redacted] como titular de la "CONSULTA DENTAL, situada en la calle [Redacted] nº 35003 de Las Palmas de Gran Canaria, para cumplimentar el TRAMITE al que fue requerido por escrito de la Consejería de Empleo Industria y Comercio,(Nº de registro de salida 819753, fecha 21/12/09), en relación con el Acta de Inspección incoada por D. [Redacted] [Redacted] comparece por medio del presente escrito al objeto de hacer las siguientes

MANIFESTACIONES:

1º- Por lo que se refiere a las desviaciones reseñadas en el documento y en orden a su corrección ,le comunico que en la actualidad tengo contratados los servicios de la **UTPR F [Redacted]**, con la finalidad de realizar la **vigilancia radiológica y control del equipo**. El objeto del contrato abarca las siguientes prestaciones:

- Asesoramiento en Protección Radiológica
- Revisión anual
- Dosimetría personal
- Desarrollo y Seguimiento anual del Programa de Protección Radiológica
- Certificado de conformidad y seguimiento anual
- Desarrollo y Seguimiento anual del Programa de Garantía de Calidad
- Formación inicial y periódica en protección radiológica del personal profesionalmente expuesto.
- Realización de Normas y procedimientos de trabajo en Protección Radiológica
- Informe anual al Consejo de Seguridad Nuclear
- Verificación de la declaración Registral.
- Especialista en Radiofísica Hospitalaria

2º- Que ya me he puesto en contacto con la UTPR [Redacted] solicitando cita ,para que a la brevedad procedan a la realización de los controles de calidad del equipo y a la vigilancia radiológica correspondiente.

3º- Que una vez realizados dichos controles remitiré a esa Inspección el informe de resultados y toda la documentación que me faciliten .

4º- Para cualquier trámite que se precise en relación con este expediente quedo a su entera disposición

En Las Palmas de Gran Canaria a 13 de enero de 2010

Fdo.: [Redacted Signature]

DILIGENCIA: En relación con el Acta de referencia CSN-CAC/AIN/01/RX/GC-2061/09, de fecha dos de diciembre de dos mil nueve, el Inspector que la suscribe declara a los comentarios formulados en el TRÁMITE de la misma:

- No cambian los contenidos del acta.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de enero de 2010


EL INSPECTOR DE IIRR

