



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día catorce de abril de dos mil nueve en el CENTRO MÉDICO CIUDAD JARDIN-CLÍNICA DENTAL, cuyo titular es CENTRO MÉDICO CIUDAD JARDÍN, de CIF [REDACTED] y que se encuentra en la calle [REDACTED], en Córdoba (C.P.- 14005).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que no se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED], Higienista dental de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.



Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS

- La instalación consta de un único equipo intraoral de la marca [REDACTED], con nº de serie ilegible, con control [REDACTED] y sin marcado CE visible. El equipo disponía de Radiovisiografía. _____
- El equipo está instalado en una sala no plomada, con un cartel visible de aviso a embarazadas, que colinda en una de sus paredes con una sala de espera. _____
- Se disponía de delantal y de collarín plomados. _____

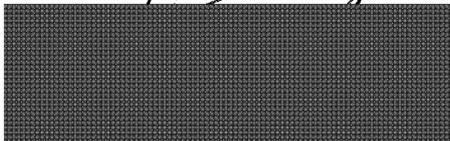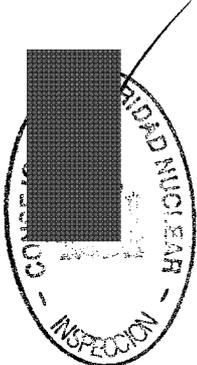

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN

- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma de agua, se midieron 5 $\mu\text{Sv/h}$ en la sala de espera adyacente. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION


- Según se manifestó, hay tres personas que dirigen la instalación: D. _____
- Estas tres personas disponen de Acreditación para Dirigir. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Hay 1 Dosímetro de Área, leído por el _____ con lecturas actualizadas y de 0'00 mSv/año. _____
- Según manifestaron, la UTPR _____ venía a realizar los controles de calidad hasta el 2007 y en el año 2008 vino la misma persona que venía con _____ aunque no disponían de los resultados de esta última revisión. _____

DESVIACIONES

- La instalación no está inscrita en el Registro oficial de la Administración de Industria de la Comunidad Autónoma. Según manifestaron, la UTPR _____ se había encargado de dicha gestión. Se incumple por tanto el artículo 8º del Real Decreto 1891/1991, de instalación y utilización de instalaciones de radiodiagnóstico médico. _____
- No estaba disponible ningún informe relativo a control de calidad realizado a lo largo del año 2008, incumpléndose por tanto la Especificación 4ª del Anexo I.2 del Real Decreto 1891/1991, de instalación y utilización de instalaciones de radiodiagnóstico médico. _____

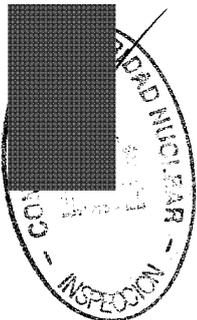


Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado

CSN
[Redacted signature area]



en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintiuno de abril de dos mil nueve.

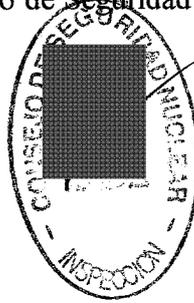


TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de la **“CENTRO MEDICO CIUDAD JARDIN- CLÍNICA DENTAL” (Córdoba)** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CSN



**CENTRO MEDICO
CIUDAD JARDIN**

C.I.F. B-14343800

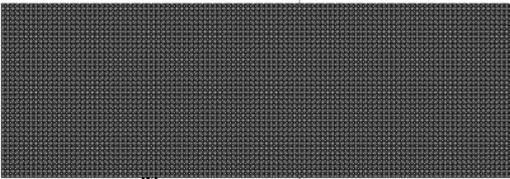

Consejo de Seguridad Nuclear
Att. 
Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 Madrid

Córdoba, 8 de mayo de 2009

Muy Sr. Mío,

En contestación al Acta de Inspección recibida con número de referencia CSN/AIN/01/VA/-0482/2009, procedemos a adjuntar el control de calidad de 2008, así como copia de la solicitud de registro de inscripción de la instalación de radiodiagnóstico, tramitada en 1994, desconociendo el motivo por el cual no está definitivamente registrada tal y como nos comunican.

Así mismo, remitimos copia del acta de inspección del 14-4-2009, sellada y firmada mostrando nuestro acuerdo con la misma.



Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Director.

Centro Médico Ciudad

14005 Córdoba

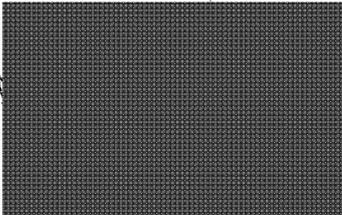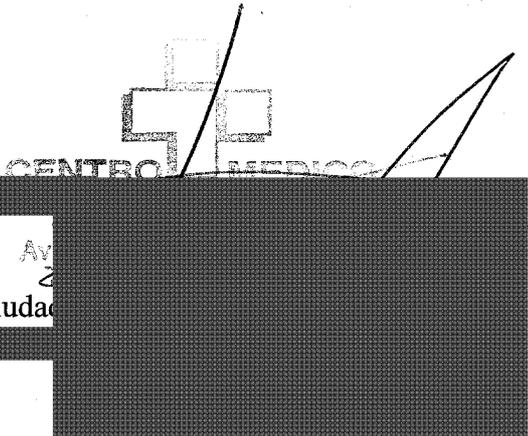

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 11091

Fecha: 13-05-2009 13:29

