



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día once de marzo de dos mil siete en la CLÍNICA DENTAL DE D. [REDACTED] cuyo titular es "MEDI & FER JEREZ SL", de [REDACTED] y que se encuentra en la Avenida [REDACTED] 8, piso 2º A, en Jerez de la Frontera, en Cadiz ([REDACTED]).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde fecha 07/03/2006.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Director de la instalación radiactiva, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES


UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se componía de dos equipos dentales intraorales y uno panorámico. La sala en que estaba instalado el equipo panorámico estaba plomada en sus paredes y puerta. Todas las salas tenían señalización y carteles de aviso a embarazadas. _____

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 9401

Fecha: 14-04-2008 13:45

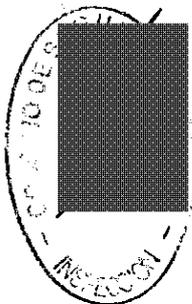

JMGG/

- Los equipos eran los siguientes:
 - Sala nº 1: un [REDACTED] con nº de serie XANE 0399.
 - Sala nº 2: un [REDACTED] con nº de serie SDXA 367.
 - Sala nº 3: un [REDACTED] [REDACTED] _____
- Disponían de delantales y collarines plomados. _____
- La ubicación del operador, en todas las salas, está en el exterior de la sala, accionando un pulsador de pared o mediante cable extensible. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma de agua, con el equipo intraoral ubicado en la sala colindante a la sala de espera, en ésta última se midió una tasa de dosis igual al fondo radiológico natural.
- Mientras se efectuaba un giro con el ortopantomógrafo, en la zona de recepción, colindante a este equipo, se medía una tasa de dosis igual al fondo natural. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION


- El Director dispone de Acreditación para dicha función. _____
- Según manifestaron, el Director es la única persona que opera los equipos. Dispone de un TLD personal cuyas lecturas, actualizadas a 11/2007, son de 0'00 mSv/5 años. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN


- Disponen de un informe de control de calidad realizado en fecha 16/01/2008 por parte de D. [REDACTED], técnico de la UTPR [REDACTED]. En dicho informe no figuran anomalías _____

DESVIACIONES

- No se detectaron. _____

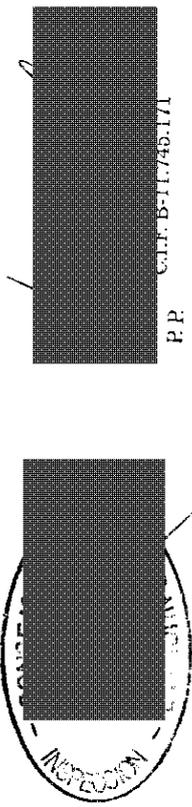

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dieciocho de marzo de dos mil ocho.

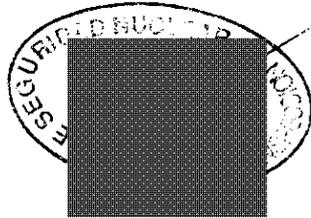

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del Centro **"MEDI & FER JEREZ SL" (Jerez de la Frontera)** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

MEDI & FER JEREZ, S.L.

