

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día treinta y uno de marzo de dos mil once en la CLINICA MÉDICA "QUIROMEDIC", cuyo titular es "Quiromedic Care and Consulting SL", con NIF [REDACTED] y que se encuentra ubicada en la calle [REDACTED] de Medina del Campo, en Valladolid (C.P.- 47400).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León desde fecha 16/02/2007.

Que la Inspección fue recibida por D^a [REDACTED] Administrativa del Centro, y D^a [REDACTED] operadora del equipo, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.

Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación consta de 1 único equipo fijo, instalado en una sala reglamentariamente señalizada y con carteles de aviso a embarazadas visibles en la sala de espera _____
- El equipo instalado, de radiografía convencional, era de la marca y modelo [REDACTED] n°/s G25445 y consola RST-HF-Rad. El tubo puede trabajar sobre una mesa fija y sobre un bucky mural. __

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- La puerta de la sala era plomada y también el visor que protegía la zona de control. _____
- Disponían de un delantal plomado. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN

- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma de agua, se hicieron medidas de tasas de dosis en la posición del operador, obteniéndose valores máximos de 9 μ Sv/h. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Según manifestaron, dirige la instalación D^a. _____
- La operadora, D^a _____ dispone de Acreditación del CSN para ello. _____
- Se disponía de 1 dosímetro personal, a nombre de la operadora habitual, cuyas lecturas actualizadas eran de 0'36 mSv en 5 años. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se disponía de un contrato escrito con la UTPR PRMédica, de fecha febrero de 2011. _____
- No se disponía de registro de incidencias o averías porque, según manifestaron, no las ha habido. _____
- Se disponía de los resultados del último control de calidad, realizado por la UTPR citada, en febrero de 2011. En él no figuran anomalías. _____

DESVIACIONES


- D^a _____ no dispone de Acreditación del CSN para Dirigir, incumpléndose por tanto el artículo 23 del Real Decreto 1085/2009 o Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico. _____

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR




Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 35/2008 por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a quince de abril de dos mil once.

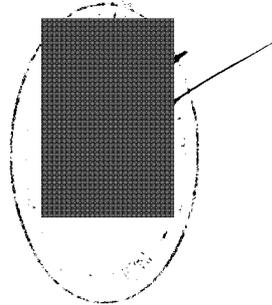

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 35/2008 citado, se invita a un representante autorizado del Centro **"CLINICA MEDICA QUIROMEDIC" (Medina del Campo)** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

VER DNEJO "MANIFESTACIONES"

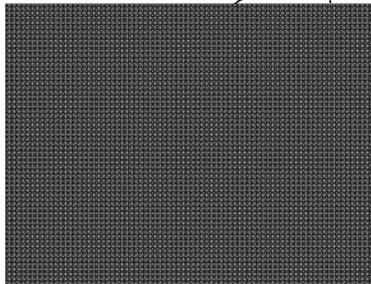

26 de abril de 2011.

DOCUMENTO DE "MANIFESTACIONES" AL ACTA EMITIDA CON FECHA 31/03/2011

REF^a: CSN/AIN/RX/VA-1459/2011

1.- *La instalación la dirige D. [REDACTED] licenciado en Medicina y Cirugía y que está habilitado como Director de Instalaciones de Rayos X, con fines de diagnóstico médico, desde 5 de abril de 1.995.*

Se adjunta la siguiente documentación:

- 1.- Copia del título emitido por Unidad de Protección Radiológica S.A.)
- 2.- Copia del título de licenciado en Medicina y Cirugía.
- 3.- Copia del "informe periódico correspondiente al año 2010" emitido por [REDACTED] y visado por nosotros el 7/03/2011.

2.- *La instalación no la dirige D^a [REDACTED], que es médico y presta sus servicios en el Centro, puesto que no dispone de Acreditación del CSN.*

3.- *La referencia que indican en el documento "acta de inspección" no es correcta puesto que el número de instalación es VA-1459 y figura Za-1459, aunque en su escrito figura correctamente.*

Fdo


DIRECTOR DE INSTALACIONES

Valladolid a 20 de abril de 2.011