





- A parte del emplazamiento principal, disponen de otro emplazamiento autorizado en una delegación de Granada [REDACTED]
- El almacén destinado a los guardar los equipos medidores de densidad y humedad de suelos se encontraba reglamentariamente señalizado, [REDACTED]. Las paredes de este almacén – colindantes con el laboratorio - disponen de un revestimiento de plomo. El día de la inspección dentro de este almacén se encontraba un equipo (n/s 3755), dentro de su maleta, señalizada conforme al Reglamento de Transporte. \_\_\_\_\_
- Disponen de un total de 3 equipos de marca [REDACTED] modelo [REDACTED] (con fuentes de Cs-137: 10 mCi y Am-241: 50 mCi, cada uno) correspondientes a:
  - n/s 3755: almacenado dentro del bunker, el día de la inspección; hasta el 10-12-07, este equipo se encontraba desplazado a la delegación de Granada. \_\_\_\_\_
  - n/s 7910 desplazado – desde su adquisición en 2006 - a la delegación de Granada. \_\_\_\_\_
  - n/s 4715 desplazado, el día de la inspección a obra en [REDACTED] (Málaga). \_\_\_\_\_
- Realizan revisiones de los equipos y control de hermeticidad a las fuentes con [REDACTED] con periodicidad semestral. Estaban disponibles los últimos certificados de fechas 16-10-07 (para todos los equipos). \_
- Disponen de tres equipos para la detección y medida de la radiación de marca MONITOR - 4, verificados y calibrados según programa establecido:
  - n/s: 36175 y 40756 verificados anualmente por [REDACTED] (última 16-10-07), y calibrados en el [REDACTED] en septiembre de 2005. \_\_\_\_\_
  - n/s: 37295, adquirido en 2006 con calibración de origen de fecha 08-09-05, verificado por [REDACTED] (última 16-10-07). \_\_\_\_\_
- Estaban disponibles los certificados correspondientes a las últimas verificaciones. \_\_\_\_\_



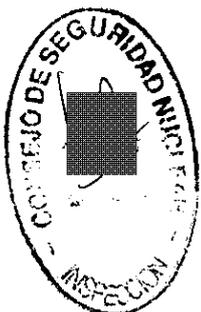


### PERSONAL – DOCUMENTACION GENERAL

- Disponen de una Licencia de Supervisor y seis de operador, en vigor. Según se manifiesta, tres de los operadores están destinados a la delegación de Granada. \_\_\_\_\_
- Han realizado un curso de formación en protección radiológica interno en fecha 31-10-07. \_\_\_\_\_
- Se efectúa la vigilancia dosimétrica de los trabajadores expuestos disponiendo de siete dosímetros personales, procesados por [REDACTED]. Los últimos registros disponibles corresponden al mes de febrero 2008, y acumulada, valores de fondo. Dosis profunda máxima acumulada en 2007: 1.84 mSv. \_\_\_\_\_
- La vigilancia sanitaria del personal profesionalmente expuesto de la instalación se efectúa en [REDACTED]. Estaban disponibles los últimos aptos médicos para todos los trabajadores. \_\_\_\_\_
- Disponen de un total de cuatro Diarios de Operación diligenciados: Uno General de toda la instalación, relleno y actualizado, y otros tres – uno para cada equipo - con los datos sobre el uso de estos y el operador correspondiente. \_\_\_\_\_
- Estaba disponible la copia del informe anual correspondiente al año 2007. \_\_\_\_\_
- Según se manifiesta disponen de la señalización reglamentaria para el transporte de equipos radiactivos así como material de balizamiento y señalización luminosa. \_\_\_\_\_
- Según se manifiesta "Disponen de un Consejero de Seguridad en el Transporte". \_\_\_\_\_
- No disponen de póliza de cobertura que cubra el transporte de material radiactivo (R.D. 2177/67). \_\_\_\_\_

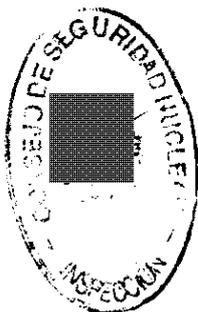


Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticuatro de abril de dos mil ocho.

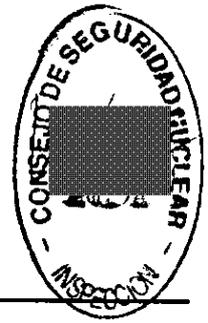

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "SEINGO", en Málaga, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*Por la presente, manifiesto nuestra conformidad al contenido de esta Acta y expreso que la información contenida en ella, no la consideramos reservada o confidencial y por tanto no presentamos ninguna oposición a que sea publicada.*

*Málaga, a 14 de Mayo de 2008*

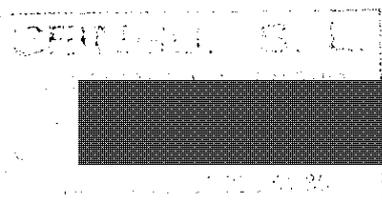

Fdo:

*[Redacted Signature]*  
SUPERVISOR DE LA I.R.R.